

boso medicus system



**BOSCH
+SOHN** boso

Gebrauchs-
anweisung



2

User
Instructions



50

Mode
d'emploi



98

Manuale
di istruzioni



146

Manual
del Usuario



194

Inhaltsverzeichnis



Geräteübersicht	4
Lieferumfang	5
Symbole auf dem Blutdruckmessgerät und in der App	6
Symbole auf dem Netzgerät	9
Kurzanleitung	10
Einführung	11
Zweckbestimmung	12
Blutdruckwerte	13
Systolischer und diastolischer Blutdruckwert	13
Grenzwerte der WHO für die Beurteilung der Blutdruckwerte	13
Inbetriebnahme des Gerätes	15
Batterien einsetzen	15
Batterie-Statusanzeige	16
Allgemeine Hinweise zur Selbstmessung des Blutdrucks	17
Allgemeine Hinweise zur Bluetooth-Verbindung	19
Vorbereitung zur Blutdruckmessung	21
Hinweis zur Manschettengröße	21

Inhaltsverzeichnis

Anlegen der Manschette	22
Blutdruckmessung	25
Abbruch der Messung	26
Messwertanzeige	27
App einrichten und Verbindung herstellen	29
Blutdruck messen und übertragen	33
Messungen auswerten und versenden	35
Messwerte löschen	37
Netzbetrieb	38
Fehleranzeige	39
Reinigung und Desinfektion	42
Garantiebedingungen	43
Kundendienst / Entsorgung	44
Technische Daten	45
Prüfanweisung für die messtechnische Kontrolle (nur für geschultes Fachpersonal)	48



Geräteübersicht

DE



Lieferumfang

1 Blutdruckmessgerät
boso medicus system



4 Batterien LR 6 (AA)



1 Universalmanschette
CA 04



1 Gebrauchs-
anweisung



1 Etui



Symbole auf dem Blutdruckmessgerät

Symbol	Funktion/Bedeutung
 DE	START
	Gleichstrom
SN	Seriennummer
	Herstellungsjahr
	Typ BF: Gerät, Manschette und Verschlauchung wurden so entwickelt, dass der Patient gegen elektrischen Schlag geschützt ist.
	Bluetooth Kommunikation aktiv.
	Messung läuft. Blinkt sobald ein Herzschlag erkannt wurde.

Symbole auf dem Blutdruckmessgerät

Symbol	Funktion/Bedeutung
	Herzrhythmus-Störung oder Bewegung während der Messung.
	Batterie voll geladen.
	Batterie teilweise entladen.
	Batterie demnächst ersetzen.
	Blinkend! Keine weitere Messung möglich. Batterien ersetzen.
	Vor Nässe schützen

Symbole auf dem Blutdruckmessgerät und in der App

Symbol	Funktion/Bedeutung
	Systolischer Blutdruck in mmHg
	Diastolischer Blutdruck in mmHg
	Puls pro Minute
	Messung mit Herzrhythmus-Störung oder Bewegung
	Gerät ist konform mit der europäischen Medizinprodukt-Richtlinie.
	Gerät darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden.
	Hersteller
	Gebrauchsanweisung lesen
	Polarität der Netzgerätanschlussbuchse

Symbole auf dem Netzgerät

Symbol	Funktion/Bedeutung
	Nur für den Betrieb in geschlossenen Räumen.
	Gerät der Schutzklasse II
	Thermosicherung
	Sicherung
	Gerät ist konform mit der europäischen Medizinproduktrichtlinie
	Polarität des Netzgerätsteckers



Kurzanleitung

DE

- Batterien einlegen, auf richtige Polung achten (S. 15)
- Manschette mit Messgerät verbinden (S. 21)
- Manschette anlegen (S. 22)
- Start (und Abbruch) einer Messung durch Betätigung der START-Taste. (S. 25)

Messwerte Systole, Diastole und Puls werden nach Ablauf der Messung angezeigt (S. 27)



Diese Kurzanleitung ersetzt nicht die in der Gebrauchsanweisung enthaltenen detaillierten Informationen zu Handhabung und Sicherheit Ihres Blutdruckmessgerätes.



Bitte lesen Sie daher unbedingt die Gebrauchsanweisung!

Einführung

Sehr geehrter Kunde, wir freuen uns sehr, dass Sie sich zum Kauf eines boso-Blutdruckmessgerätes entschieden haben. Die Marke boso steht für höchste Qualität und Präzision und ist auch bei den Profis die Nummer 1: 96% aller deutschen Allgemeinärzte, Praktiker und Internisten arbeiten in der Praxis mit Blutdruckmessgeräten von boso (API-Studie der GfK 01/2016). Die jahrzehnte-lange Erfahrung aus dem Profi-Bereich steckt auch in allen Patientengeräten für die Selbstmessung zu Hause.

Dieses Gerät hat unsere strenge Qualitätskontrolle durchlaufen und ist Ihr sicherer Partner für die Kontrolle Ihrer Blutdruckwerte.

⚠ Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor der erstmaligen Anwendung sorgfältig durch, denn eine korrekte

Blutdruckmessung ist nur bei richtiger Handhabung des Geräts möglich.

In dieser Gebrauchsanweisung wird „**→**“ für eine Aktion des Anwenders verwendet.



Um Hilfe bei der Inbetriebnahme, Benutzung oder Wartung zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhandel oder an den Hersteller (Kontaktdaten auf der hinteren Umschlagseite dieser Gebrauchsanweisung).

Ein unerwarteter Betriebszustand oder ein Vorkommnis welches den gesundheitlichen Zustand verschlechtert hat oder hätte verschlechtern können ist dem Hersteller unverzüglich zu melden.

Bei Veräußerung des Gerätes ist diese Gebrauchsanweisung beizulegen.

Einführung



Das Blutdruckmessgerät boso-medicus system ist für Patienten geeignet, deren Oberarmumfang zwischen 22 und 48 cm liegt.

Die Verwendung von Zubehör, welches in dieser Gebrauchsanweisung nicht genannt ist, kann die Sicherheit beeinträchtigen.

Drahtlose Kommunikationsgeräte, wie z.B. drahtlose Heimnetzwerk-Geräte, Handys, schnurlose Telefone und deren Basisstationen, Walkie-Talkies können dieses Blutdruckmessgerät beeinflussen. Daher sollte zu solchen Geräten ein Abstand von mindestens 30 cm gehalten werden.

Die Bluetooth-Funkübertragung des Gerätes entspricht der Funkgeräte-Richtlinie 2014/53/EU.

Zweckbestimmung

Nichtinvasive Erfassung des systolischen und diastolischen Blutdruckwertes sowie der Pulsfrequenz von Erwachsenen.

Nicht geeignet für die Anwendung bei Neugeborenen und Kleinkindern.

Das Gerät ist für den Einsatz bei der Selbstmessung zu Hause geeignet. Der Patient ist als Bediener vorgesehen.

Das Gerät kann mit jedem Armmumfang wie auf der zugehörigen Manschette angegeben verwendet werden.

Blutdruckwerte

Um den Blutdruck zu ermitteln, müssen **zwei Werte** gemessen werden:

- **Systolischer (oberer) Blutdruckwert:** Er entsteht, wenn der Herzmuskel sich zusammenzieht und das Blut in die Blutgefäße gedrückt wird.

- **Diastolischer (unterer) Blutdruckwert:** Er liegt vor, wenn der Herzmuskel gedehnt ist und sich wieder mit Blut füllt.



Die Messwerte des Blutdruckes werden in mmHg (mm Quecksilbersäule) angegeben.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat folgende Grenzwerte für die Beurteilung der Blutdruckwerte festgelegt:

	systolisch	diastolisch
Eindeutig erhöhter Blutdruck (Hypertonie)	ab 140 mmHg	ab 90 mmHg
Noch normaler Blutdruck	130 bis 139 mmHg	85 bis 89 mmHg
Normaler Blutdruck	120 bis 129 mmHg	80 bis 84 mmHg
Optimaler Blutdruck	bis 119 mmHg	bis 79 mmHg

Blutdruckwerte



Wann eine medikamentöse Therapie erforderlich ist, hängt nicht allein vom Blutdruck ab, sondern auch vom Risikoprofil des Patienten. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt, wenn nur einer der beiden Werte (Systole, Diastole) ständig über den Grenzwerten für eindeutig erhöhten Blutdruck liegt.

Bei der Blutdruck-Selbstmessung zu Hause werden häufig etwas niedrigere Werte als beim Arzt gemessen. Deshalb hat die Deutsche Hochdruckliga für die Messung zu Hause tiefere Grenzwerte festgelegt:

Messung zu Hause: 135/85 mmHg

Messung in der Arztpraxis: 140/90 mmHg

Inbetriebnahme des Gerätes

Das Gerät muss gemäß den Informationen in dieser Gebrauchsanweisung installiert und in Betrieb genommen werden.

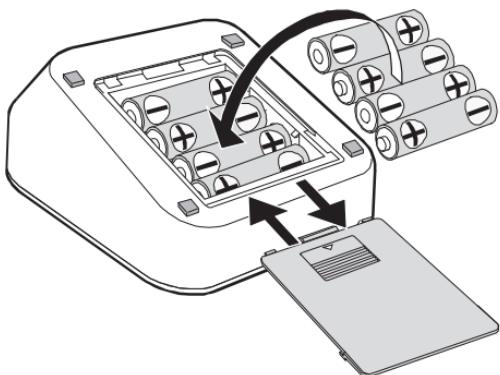


Bild 1

- Verwenden Sie ausschließlich hochwertige, auslaufsichere Batterien der angegebenen Spezifikation (siehe „Technische Daten“ S. 45).

⚠ Mischen Sie **nie** alte und neue Batterien oder verschiedene Fabrikate.

⚠ Bei falscher Polung funktioniert das Gerät nicht und es kann zu Wärmebildung oder Auslaufen der Batterien und zur Zerstörung des Gerätes kommen.

→ Batterien einsetzen

Das Batteriefach befindet sich auf der Unterseite des Gerätes. Setzen Sie die Batterien entsprechend Bild 1 im Batteriefach ein.

→ Wird das Gerät längere Zeit gelagert, die Batterien herausnehmen.

⚠ Sollten die Batterien kurzgeschlossen werden, können sie heiß werden und es kann zu Verbrennungen führen.

DE

Inbetriebnahme des Gerätes

Das Gerät besitzt eine Statusanzeige für den Batterieladezustand (siehe S. 7)



-  Batterie voll geladen.
-  Batterie teilweise entladen.
-  Batterie demnächst ersetzen.
-  blinkend! Keine weitere Messung möglich.
Batterie ersetzen.



Leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz

Verbrauchte Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll.

Sie können diese bei einer Sammelstelle für Altbatterien bzw. Sondermüll abgeben. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Gemeinde.

Allgemeine Hinweise zur Selbstmessung des Blutdruckes

1. Blutdruckschwankungen sind normal. Selbst bei einer Wiederholungsmessung können beachtliche Unterschiede auftreten. Einmalige oder unregelmäßige Messungen liefern keine zuverlässige Aussage über den tatsächlichen Blutdruck. Eine zuverlässige Beurteilung ist nur möglich, wenn Sie regelmäßig unter vergleichbaren Bedingungen messen und die Messwerte im Blutdruckpass aufschreiben.
2. **⚠️** Selbstmessung bedeutet noch keine Therapie. Verändern Sie auf **keinen** Fall von sich aus die vom Arzt vorgeschriebene Dosierung der Arzneimittel.
3. Herzrhythmus-Störungen können die Messgenauigkeit des Gerätes beein- trächtigen, bzw. zu Fehlmessungen führen (siehe Seite 40).
4. Bei Patienten mit schwachem Puls (möglich z.B. bei Trägern von Herzschrittmachern) kann es zu Fehlmessungen kommen. Das Blutdruckmessgerät hat keinen Einfluss auf den Herzschrittmacher.
5. Das Gerät wurde nicht für die Anwendung bei Schwangeren validiert.
6. Die Messung muss immer im Ruhezustand vorgenommen werden. Es empfiehlt sich, den Blutdruck zweimal täglich zu kontrollieren – morgens nach dem Aufstehen und abends, wenn Sie sich nach der Arbeit entspannt haben.



Allgemeine Hinweise zur Selbstmessung des Blutdruckes



7. Der Blutdruck muss (wenn keine Einschränkungen (siehe Seite 23) vorliegen) immer an dem Arm mit den höheren Druckwerten gemessen werden. Hierzu messen Sie den Blutdruck zuerst an beiden Armen und danach immer an dem Arm dessen Blutdruckwert höher ist.

Allgemeine Hinweise zur Bluetooth-Verbindung

- **⚠️** Das Blutdruckmessgerät darf nicht an Orten verwenden, an denen drahtlose Kommunikation verboten ist, wie z.B. in Flugzeugen oder Krankenhäusern. Dieses Blutdruckmessgerät kann ungünstige Auswirkungen auf elektronische Geräte oder medizinische elektrische Geräte haben.
- Die maximale Kommunikationsentfernung zwischen Blutdruckmessgerät und Empfänger beträgt ca. 10 Meter. Dieser Abstand kann sich aufgrund der Umgebung verringern; prüfen Sie daher, ob die Entfernung für die Übertragung von Daten nach der Messung gering genug ist.
- Sorgen Sie dafür, dass der Raum zwischen dem Blutdruckmessgerät und dem Mobilgerät unverbaut ist. Die Kommunikationsentfernung kann durch die Bauausführung des Gebäudes oder sonstige Hindernisse verkürzt sein. Insbesondere ist eine Kommunikation durch Stahlbetonwände usw. unter Umständen nicht möglich.
- Während der Kopplung muss auf allen anderen in Reichweite befindlichen Geräten Bluetooth deaktiviert sein
- Sollte der unwahrscheinliche Fall eintreten, dass dieses Blutdruckmessgerät andere drahtlose Kommunikationsge-



Allgemeine Hinweise zur Bluetooth-Verbindung

räte stört, verwenden Sie das Blutdruckmessgerät an einem anderen Standort.



- Verwenden Sie die Bluetooth-Verbindung nicht in der Nähe eines IEEE802.11g/b/n-WLAN-Geräts oder sonstiger drahtloser Kommunikationsanlagen (insbesondere im Bereich von 2,4 GHz) bzw. in der Nähe von Geräten, die elektromagnetische Wellen aussenden (wie z.B. Mikrowellengeräten). Dies kann dazu führen, dass die Verbindung häufig unterbrochen wird, die Kommunikationsgeschwindigkeit deutlich abnimmt und Fehler auftreten.

Vorbereitung zur Blutdruckmessung

Hinweis zur Manschettengröße:

⚠ Das Gerät darf nur mit folgenden Manschetten verwendet werden. Diese müssen entsprechend dem aufgedruckten Oberarm-Umfang gewählt werden.

Typ	Armumfang	Bestellnummer
CA01	22 – 32 cm	143-4-764
CA02	32 – 48 cm	143-4-757
CA04	22 – 42 cm	143-4-765*

* Universalmanschette im Standardlieferumfang enthalten.

Verbinden Sie die Manschette mit dem Gerät, indem Sie den Stecker (einrastend) in die Buchse auf der linken Seite des Gerätes eindrücken. (Siehe Bild 2).

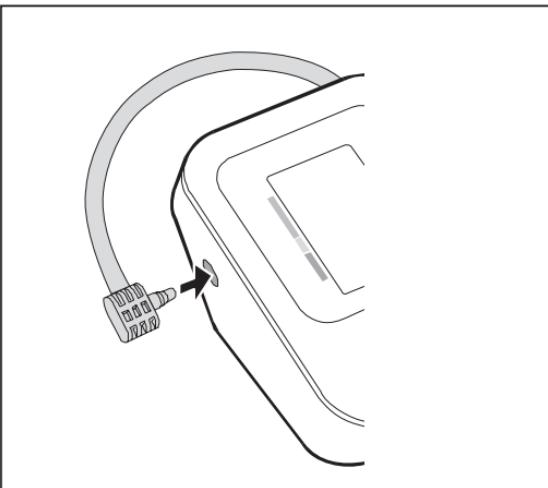


Bild 2

Vorbereitung zur Blutdruckmessung

Folgendes muss bei der Blutdruckmessung beachtet werden:



Meiden Sie eine Stunde vor der Blutdruckmessung Nikotin und Kaffee.



Sitzen Sie zur Blutdruckmessung bequem. Lehnern Sie Rücken und Arme an. Kreuzen Sie die Beine nicht. Stellen Sie die Füße flach auf den Boden.

Entspannen Sie sich 5 Minuten und messen Sie erst dann.

Bewegen Sie sich nicht während der Messung.

Anlegen der Manschette

Die Messung ist am unbekleideten Oberarm durchzuführen.



Achten Sie darauf, dass der Arm bei eng anliegender Oberbekleidung durch das Hochkremeln des Ärmels nicht abgeschnürt wird (gegebenenfalls das Kleidungsstück vor dem Messen ablegen).

→ Streifen Sie die zu einem Ring geöffnete Manschette über den Oberarm bis der untere Manschettenrand ca. 2-3cm oberhalb der Armbeuge liegt. Die Manschette muss so platziert werden, dass die Markierung auf der Arterie liegt (siehe Bild 3).

Vorbereitung zur Blutdruckmessung

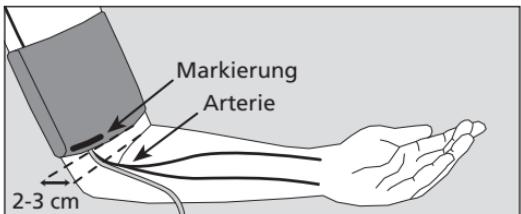


Bild 3

⚠ Die Manschette darf nicht über Wunden angelegt werden, da dies zu weiteren Verletzungen führen kann.

⚠ Achten Sie darauf, dass die Manschette nicht an einem Arm angelegt wird, dessen Arterien oder Venen in medizinischer Behandlung sind oder waren (z.B. Shunt).

⚠ Bei Frauen mit Brustamputation die Manschette nicht am Arm auf der amputierten Körperseite anlegen.

⚠ Während der Messung können Fehlfunktionen bei Medizingeräten auftreten, die zeitgleich am selben Arm verwendet werden.



⚠ Die Manschette darf nicht zu fest anliegen, es sollen noch etwa zwei Finger zwischen Arm und Manschette passen.

⚠ Der Metallbügel darf **niemals** über der Arterie liegen (siehe Bild 3) da sonst die Messwerte verfälscht werden könnten.

→ Ziehen Sie das durch den Metallbügel geführte Manschettenende an und schlagen es nach außen um den Oberarm. Durch leichtes Andrücken haftet der Klettverschluss sicher.

Vorbereitung zur Blutdruckmessung

- Legen Sie den Arm mit der angelegten Manschette entspannt und leicht abgewinkelt auf den Tisch, so dass sich die Manschette in Herzhöhe befindet.

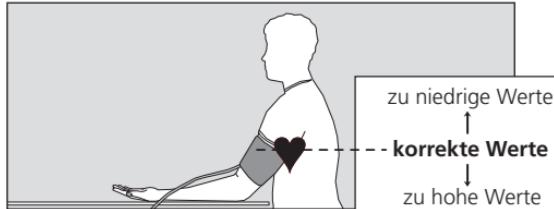


Bild 4



Während der Messung nicht sprechen.

⚠ Achten Sie darauf, dass der Luftschaft während der Messung nicht geknickt ist. Ein dadurch resultierender Blutstau könnte zu Verletzungen führen.

⚠ Der Blutfluss darf durch die Blutdruckmessung nicht unnötig lange (> 2 Minuten) unterbunden werden. Bei einer Fehlfunktion des Gerätes nehmen Sie die Manschette vom Arm ab.

⚠ Zu häufige Messungen können durch Beeinträchtigung des Blutflusses zu Verletzungen führen.

⚠ Das Gerät darf von Kindern nicht unbeaufsichtigt benutzt werden.

⚠ Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Säuglingen. Dies kann zu Unfällen oder Beschädigungen führen.

⚠ Das Gerät nicht starten, ohne die Manschette anzulegen.

⚠ Das Gerät enthält kleine Teile, diese können eine Erstickungsgefahr verursachen, wenn sie von Säuglingen versehentlich verschluckt werden.

⚠ Wenn sich die Umgebungstemperatur wesentlich ändert, geben Sie dem Gerät ca. eine Stunde Zeit um sich an die neue Umgebungstemperatur anzupassen bevor Sie es verwenden.

⚠ Die Leistung des Gerätes kann durch übermäßige Temperatur, Feuchtigkeit oder Höhe beeinflusst werden.

Blutdruckmessung

- Starten Sie die Messung mit der START-Taste



⚠ Jetzt den Arm vollkommen ruhig halten und nicht sprechen.

Zur Funktionskontrolle erscheinen kurz sämtliche Anzeigeelemente der LCD-Anzeige (siehe Bild 5).

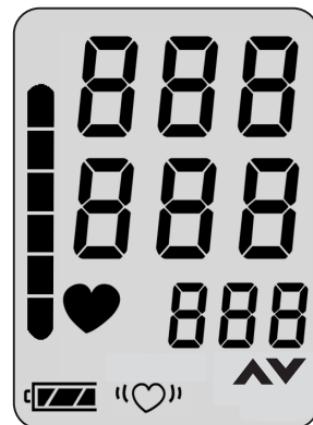


Bild 5



Blutdruckmessung

DE

Die Pumpe beginnt die Manschette aufzupumpen.

Das Gerät besitzt eine intelligente Aufpump-Automatik für schonendes Aufpumpen auf den richtigen Manschettendruck. Der steigende Manschettendruck wird als digitaler Zahlenwert und in Form von Balken am linken Displayrand angezeigt.

Bei Erreichen des **erforderlichen Drucks** schaltet die Pumpe ab, und die Luft entweicht langsam aus der Manschette.



Abbruch der Messung:

Eine Messung kann jederzeit abgebrochen werden, indem Sie während einer laufenden Messung die START-Taste drücken,

wodurch die Manschette automatisch entlüftet wird.

Während der Messphase wird der fallende Manschettendruck und das blinkende Herz-Symbol angezeigt (siehe Bild 6).



Bild 6

Messwertanzeige

Nach Ende der Messung öffnet sich automatisch das eingebaute Ventil zur Schnellentlüftung der Manschette.

Die gemessenen Blutdruckwerte (Systole, Diastole, Puls) der Messung werden angezeigt (siehe Bild 7).



Systole
mmHg

Diastole
mmHg

Puls/min.

Erscheint nach der Messung das Symbol „(♥)“, wird eine Wiederholungsmessung empfohlen, dabei den Arm vollkommen ruhig halten. Die wiederholte Anzeige des Symbols „(♥)“ bei ruhig gehaltenem Arm kann ein Hinweis auf Herz-Rhythmus-Störungen sein. Bitte besprechen Sie dies bei Ihrem nächsten Arztbesuch.

Der Blutdruck ist eine dynamische Größe und kann durch die Haltung des Patienten wie Sitzen, Stehen, Liegen, Bewegung vor oder während der Messung, körperliche Verfassung (Stress, Krankheit...) beeinflusst werden.

→ Bei offensichtlich falschem Messergebnis die Messung wiederholen.

Bild 7

Messwertanzeige

Nach ca. 1 min. schaltet das Gerät automatisch ab. Um eine Wiederholungsmessung durchzuführen ist erneut die START-Taste **kurz** zu drücken.

DE



Lassen Sie zwischen zwei Messungen mindestens zwei Minuten vergehen.

- Wird keine weitere Messung gewünscht, nehmen Sie die Manschette vom Arm ab.

App einrichten und Verbindung herstellen



Erfordert Interaktion mit der boso-App



Erfordert Interaktion mit dem boso medicus system

Um den Datenaustausch zwischen dem Blutdruckmessgerät und Ihrem Mobilgerät zu ermöglichen, müssen folgende Schritte beachtet werden:



- Stellen Sie sicher, dass auf Ihrem Mobilgerät Bluetooth aktiviert ist. (Voraussetzung ist die Verfügbarkeit von Bluetooth 4.0)

– Laden Sie die boso-App aus dem Google/Apple Store.



Bei der Installation der App wird durch das Betriebssystem (Android/iOS) die Erlaubnis auf den Zugriff des aktuellen Standorts abgefragt.

Diese Abfrage ist mit „JA“ zu beantworten um Fehler bei der BT-Verbindung zu vermeiden.


Hinweis: Die Information „aktueller Standort“ wird nicht von der boso-App verlangt, sondern vom Betriebssystem für die Bluetooth Verbindung.

App einrichten und Verbindung herstellen



DE

- Starten Sie die boso-App auf Ihrem Mobilgerät.
- Anlegen eines neuen Benutzers:
 1. Wählen Sie „Benutzer“ im Hauptmenü aus.
 2. Wählen Sie „+ Neu“ in der unteren Menüleiste aus.
 3. Geben Sie Ihre persönlichen Daten ein. Pflichtfelder sind mit „*“ gekennzeichnet.
 4. Speichern Sie Ihre Eingabe über den Button „Speichern“ in der unteren Menüleiste.
- Markieren Sie den gewünschten Benutzer indem Sie einen Haken setzen, für den die Messwerte gespeichert werden sollen.

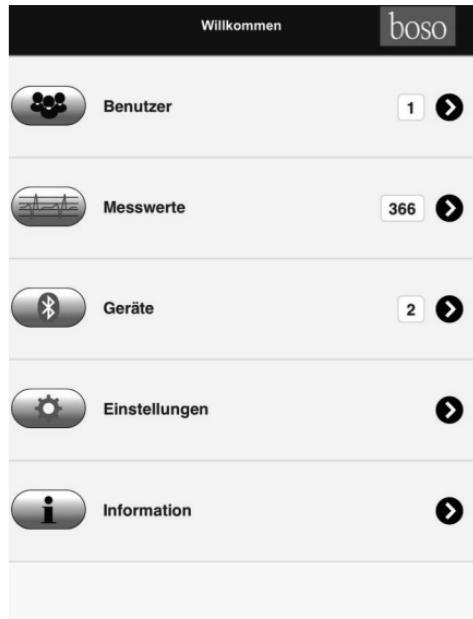

App einrichten und Verbindung herstellen



- Gehen Sie über den Button „Zurück“ in der oberen Menüleiste zurück in das Hauptmenü.
- Öffnen Sie im Hauptmenü „Geräte“.



- Drücken und halten Sie am Blutdruckmessgerät die START-Taste so lange bis im Display „Pr“ erscheint. Die Kommunikationsanzeige wird für ca. eine Minute im Display angezeigt.
- Im Menü „Geräte“ wählen Sie „Neues Gerät hinzufügen“ in der unteren Menüleiste aus.



Bei iOS muss zusätzlich die Kopplungsanfrage durch „Koppeln“ bestätigt werden.



– Datum und Uhrzeit werden automatisch von dem Mobilgerät synchronisiert.



– Nach erfolgreicher Kopplung erscheint „End“ im Display des Gerätes und das Gerät wird in der Geräteliste der App angezeigt.

Die Einrichtung ist nun abgeschlossen. Verlassen Sie nun das Menü über den Button „Zurück“ in der oberen Menüleiste.

App einrichten und Verbindung herstellen

DE

Nach einem Batteriewechsel muss das Blutdruckmessgerät erneut mit dem Mobilgerät gekoppelt werden, da die Zeitinformation durch den Batteriewchsel gelöscht wird.

Ohne erneute Kopplung wird bei der Datenübertragung die aktuelle Systemzeit des Mobilgerätes als Zeitstempel für die Messwerte gespeichert.

Bitte gehen Sie hierbei wie folgt vor:

- Blutdruckmessgerät in der Geräteliste der App löschen
- Blutdruckmessgerät aus den Bluetootheinstellungen des Mobilgerätes löschen
- Neue Kopplung wie beschrieben durchführen.

Blutdruck messen und übertragen

DE

Legen Sie nun die Manschette an und führen Sie eine Blutdruckmessung durch wie in der Gebrauchsanweisung beschrieben.



Solange Bluetooth aktiv und die App geöffnet ist, werden die gemessenen Werte automatisch im Anschluss an die Blutdruckmessung übertragen.



Nach erfolgreicher Übertragung wird der Messwert aus dem Messwertspeicher des Blutdruckmessgerätes gelöscht.



Sollten die Messdaten nicht übertragen worden sein, führen Sie die Kopplung erneut durch. Bei inaktiver App bzw. inaktivem Bluetooth

werden bis zu 30 Messwerte automatisch im Blutdruckmessgerät gespeichert. Ist der Messwertspeicher voll, so wird die älteste Messung gelöscht und die aktuelle Messung gespeichert. Die Messwerte werden im Anschluss an die nächste Messung nach Aktivierung der App übertragen.

Um alle gespeicherten Messwerte die sich im Messwertspeicher des medicus system befinden in die App zu übertragen, muss im Menü „Einstellungen“ die Messwertübernahme aller Messwerte aktiviert sein (Standardeinstellung). Wird hier „letzter“ ausgewählt, so wird immer nur der zuletzt gemessene Messwert übertragen und alle


Blutdruck messen und übertragen

DE

gespeicherten Messwerte im Gerät gelöscht.

Im Menü „Einstellungen“ können auch die Zeiten für die Vormittag- / Nachmittag-Auswertung geändert werden.

Speichern Sie Ihre Einstellungen über den Button „Speichern“ in der unteren Menüleiste.

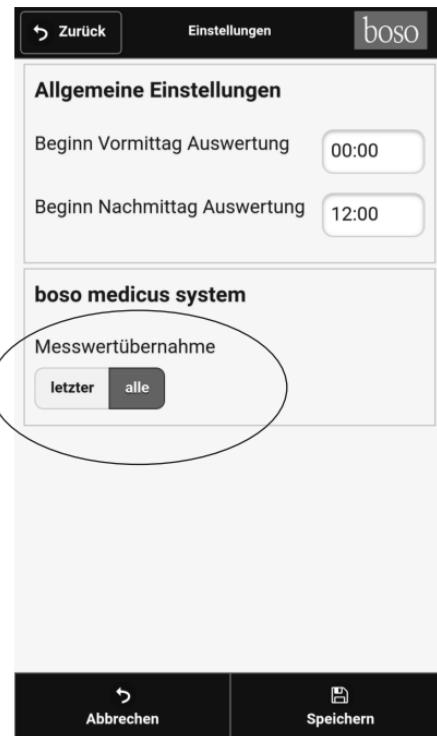

Messungen auswerten und versenden




Im Menü „Messwerte“ werden alle bisher übertragenen Messwerte angezeigt.

Über den Button „Grafiken“ in der unteren Menüleiste erreichen Sie die grafische Darstellung der Messwerte.

Die Auswahl der verfügbaren Grafiken „SYS/DIA“, „PULS“ erfolgt über die Buttons im oberen Bildschirmbereich. Durch Antippen der Grafik wird diese vergrößert bzw. verkleinert.

„kg/BMI“ ist für eine Waage vorgesehen.

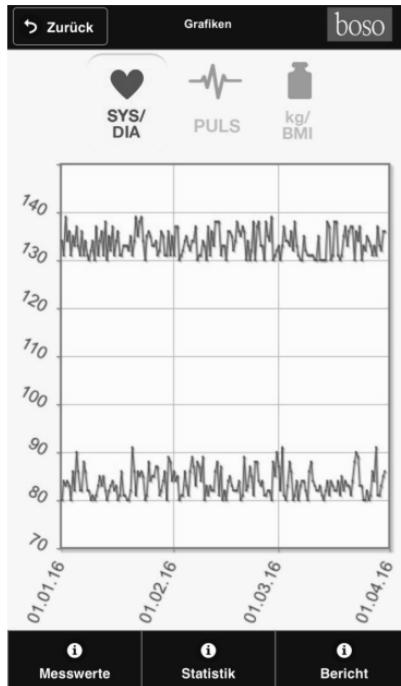

Messungen auswerten und versenden



DE

Über den Button „Statistik“ in der unteren Menüleiste erreichen Sie die statistische Zusammenfassung der Messwerte. Der Zeitbereich für die Zusammenfassung (Datum von/bis) kann ausgewählt werden.

Über den Button „Bericht“ in der unteren Menüleiste erreichen Sie das Menü für den Versand der Messwerte. Hier kann die Zusammenfassung im PDF- oder XML-Format per Email versendet werden.

Die XML-Datei kann im PC-Programm „boso profil-manager XD Home“ eingelesen werden.

Dieses Programm bietet weitere Auswertungsmöglichkeiten und ist im Internet (<http://www.boso.de/download/profilmanagerXDHome/>) kostenlos verfügbar.

The screenshot shows the 'Bericht' (Report) screen of the bosoprofil software. At the top, there are buttons for 'Zurück' (Back) and 'Bericht'. The 'boso' logo is in the top right corner. Below the buttons, there are fields for 'An:' (To:) and 'Kopie:' (Cc:), each with a search icon. Underneath these is a large text area labeled 'Email Text:' with a placeholder 'Hier können Sie Ihren Text eingeben.' (Here you can enter your text.). At the bottom, there are two buttons: 'Als XML senden' (Send as XML) and 'Als PDF senden' (Send as PDF).

Messwerte löschen



Einzelne ausgewählte Messwerte bzw. Messwerte die älter als 1/3/6/12 Monate sind, können im Menü „Messwerte“ über den Button „Löschen“ in der unteren Menüleiste gelöscht werden.

Achtung, die Daten werden unwiderruflich gelöscht. Bitte führen Sie rechtzeitig eine Datenarchivierung durch, indem Sie über den Button „Bericht“ eine XML bzw. PDF-Datei erstellen.

	SYS	DIA	PUL	Arr	kg	
17.10.2018 11:09:00	-	-	-	-	85	<input type="checkbox"/>
30.03.2016 18:00:00	136	86	66	-	-	<input type="checkbox"/>
30.03.2016 08:00:00	-	-	-	-	78,5	<input type="checkbox"/>
30.03.2016 08:00:00	136	85	68	-	-	<input type="checkbox"/>
29.03.2016 18:00:00	-	-	-	-	78,8	<input type="checkbox"/>
29.03.2016 18:00:00	132	83	67	-	-	<input type="checkbox"/>
29.03.2016 08:00:00	-	-	-	-	78,7	<input type="checkbox"/>
29.03.2016 08:00:00	133	81	65	-	-	<input type="checkbox"/>
28.03.2016	-	-	-	-	78,9	<input type="checkbox"/>



Netzbetrieb

DE

Auf der Rückseite des Gerätes befindet sich die Anschlussbuchse für das Netzgerät. Verwenden Sie im Bedarfsfall nur das boso-Netzgerät (**Bestell-Nr. 410-7-150**). Dieses Netzgerät ist in der Spannung genau abgestimmt, stabilisiert und richtig gepolt. Fremd-Netzgeräte können eine Schädigung der Elektronik verursachen und den Verlust der Werksgarantie zur Folge haben. Weiterhin kann von Fremd-Netzteilen eine Brandgefahr ausgehen.

⚠️ Berühren Sie nicht Batterien, die Netzgerätanschlussbuchse und den Patienten gleichzeitig.

⚠️ Ziehen Sie den Netzgerätstecker aus dem Blutdruckmessgerät wenn es nicht benutzt wird.

Fehleranzeige

Treten während der Messung Probleme auf, so wird anstatt des Messergebnisses ein Fehler angezeigt.

Bedeutung der Fehleranzeigen:

(DE)

Fehlerursache:	Fehlerbehebung:
	Manschettendruck schwankt während der Messung zu stark keine auswertbaren Pulsationen
	Differenz Systole – Diastole zu gering: Systole – Diastole ≤ 10 mmHg
	Fehler beim Aufpumpen
	Arm ruhig halten Lage der Manschette überprüfen (siehe Seite 22) und erneut messen.
	Lage der Manschette überprüfen (siehe Seite 22) und erneut messen
	evtl. Manschette zu locker angelegt, Manschette fester anlegen (siehe Seite 22)

Fehleranzeige

DE

Fehlerursache:	Fehlerbehebung:
	Der Pulswert konnte nicht korrekt ermittelt werden.
	Interner Gerätefehler Entnehmen Sie die Batterien und drücken Sie kurz die START-Taste. Legen Sie die Batterien wieder ein. Sollte der Fehler weiterhin bestehen, senden Sie das Gerät zur Reparatur an den Hersteller.
	
	“♥” Anzeige: Wiederholungsmessung empfohlen; dabei Arm vollkommen ruhig halten. Die wiederholte Anzeige des Symbols “♥” bei ruhig gehaltenem Arm kann ein Hinweis auf Herz-Rhythmus-Störungen sein. Bitte besprechen Sie dies bei Ihrem nächsten Arztbesuch.

Fehleranzeige

DE

Fehlerursache:	Fehlerbehebung:
 Err 10	Entnehmen Sie die Batterien und drücken Sie kurz die START-Taste. Legen Sie die Batterien wieder ein. Führen Sie erneut eine Kopplung durch. Sollte der Fehler weiterhin bestehen, senden Sie das Gerät zur Reparatur an den Hersteller.
 Err 11	Bei der Installation der App wird systembedingt die Erlaubnis auf den Zugriff des aktuellen Standorts abgefragt. Diese Abfrage ist mit "JA" zu beantworten um Fehler bei der BT-Verbindung zu vermeiden.

Reinigung und Desinfektion



Reinigung Gerät:

Zur Reinigung des Gerätes verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch.

Reinigung Manschette:

Kleine Flecken auf der Manschette können vorsichtig mit handelsüblichem Geschirrspülmittel entfernt werden.

Desinfektion:

Zur Wischdesinfektion (Einwirkzeit mind. 5 Minuten) des Gerätes empfehlen wir das Desinfektionsmittel antifect liquid (Schülke & Mayr). Zur Desinfektion der Manschette empfehlen wir die Sprühdesinfektion.

Insbesondere wenn das Gerät von mehreren Anwendern verwendet wird, ist auf eine regelmäßige Reinigung und Desinfektion der Manschette zu achten.

Garantiebedingungen

Für dieses Produkt leisten wir 3 Jahre Werksgarantie ab Kaufdatum. Das Kaufdatum ist durch Rechnung nachzuweisen. Innerhalb der Garantiezeit werden Mängel infolge von Material- oder Fertigungsfehlern kostenlos beseitigt. Durch die Garantieleistung tritt keine Verlängerung der Garantiezeit auf das ganze Gerät ein, sondern nur auf die ausgewechselten Bauteile.

Von der Garantieleistung ausgenommen ist die Abnutzung durch Verschleiß (z.B. Manschette), Transportschäden sowie alle Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung (z.B. Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung) entstanden sind oder auf Eingriffe von Unbefugten zurückzuführen sind. Durch die Garantie werden keine Schadenersatzansprüche gegen uns begründet.

Die gesetzlichen Mängelansprüche des Käufers gemäß § 437 BGB werden nicht eingeschränkt.



Im Falle der Inanspruchnahme der Garantie ist das Gerät zusammen mit dem Original-Kaufbeleg zu senden an:
BOSCH + SOHN GMBH U. CO. KG
Bahnhofstr. 64, D-72417 Jungingen.

boso übernimmt keinerlei Verantwortung für entstandene Verluste wie z.B. Betriebsstörungen oder Datenverluste, die durch die Verwendung dieses Blutdruckmessgerätes auftreten können.

Es wird nicht garantiert, dass dieses Blutdruckmessgerät mit allen Bluetooth-kompatiblen Geräten eine Verbindung herstellen kann.

Kundendienst



Kundendienst:

Garantie- und Reparaturarbeiten müssen durch geschultes und autorisiertes Personal durchgeführt werden. Das Gerät darf ohne Erlaubnis des Herstellers nicht geändert werden. Senden Sie das Gerät sorgfältig verpackt und ausreichend frankiert an Ihren autorisierten Fachhändler oder direkt an:

BOSCH + SOHN GmbH u. Co. KG
Serviceabteilung
Bahnhofstraße 64, D-72417 Jungingen
T: +49 (0) 74 77 / 92 75-0

Entsorgung



Geräte und Batterien dürfen nicht in den Hausmüll.

Am Ende der Nutzungsdauer muss das Gerät einer Sammelstelle für Elektronik-Altereile zugeführt werden.

Bitte beachten Sie, dass Batterien und wiederaufladbare Batterien hierbei gesondert entsorgt werden müssen. (Sammelstelle Ihrer Gemeinde).

Zu erwartende Betriebs-Lebensdauer des Gerätes: 5 Jahre (bei Benutzung 6 x am Tag).

Zu erwartende Betriebs-Lebensdauer der Manschette: 2 Jahre (bei Benutzung 6 x am Tag).

Technische Daten

Messprinzip:	Oszillometrisch
Messbereich:	Systolisch: 60 bis 279 mmHg Diastolisch: 40 bis 200 mmHg Puls: 40 bis 180 pro Minute
Manschettendruck:	0 bis 299 mmHg
Anzahl Speicher:	30 Messungen
Anzeige:	LCD
Betriebsbedingungen:	Umgebungstemperatur +10°C bis +40°C rel. Luftfeuchtigkeit 15 bis 85 % Luftdruck 800 hPa bis 1060 hPa
Transport/ Lagerbedingungen:	Umgebungstemperatur –20°C bis +60°C rel. Luftfeuchtigkeit 10 bis 95 % Luftdruck 700 hPa bis 1060 hPa
Stromversorgung:	DC 6 V (Batterien 4 x 1,5 V Mignon IEC LR 6, Alkali Mangan) alternativ als Sonderausstattung: Netzgerät DC 6 V, Best.-Nr. 410-7-150



Technische Daten



Typische Lebensdauer der Batterien: 500 Messzyklen (abhängig von Aufpumphöhe und Nutzungsfrequenz)

Batteriekontrolle: Symbol-Anzeige im Anzeigefeld

Gewicht: 250 g ohne Batterien

Abmessungen (B x H x T): 96 mm x 68 mm x 130 mm

Klassifikation: Medizinprodukt mit interner Energiequelle (im Batteriebetrieb) / Klasse II (im Netzteilbetrieb),
Kontinuierlicher Betriebsmodus

Anwendungsteil: Typ BF (█)

Schutz gegen Fremdkörper: IP20
Die IP-Klassifizierung ist die Schutzart, die von Gehäusen gemäß IEC 60529 besteht. Dieses Gerät ist gegen feste Fremdkörper mit einem Durchmesser von 12 mm und größer wie z. B. Fingern geschützt.
Dieses Gerät ist nicht gegen Wasser geschützt.

Technische Daten

Klinischer Test: die Messgenauigkeit entspricht den Anforderungen der ISO 81060 Teil 2

Bluetooth: Bluetooth Version 4.0



maximale Messabweichung des Manschettendrucks: $\pm 3 \text{ mmHg}$ oder 2% des Ablesewertes
(der größere Wert gilt)

maximale Messabweichung der Pulsanzeige: $\pm 5 \%$

Zutreffende Norm: DIN EN ISO 80601-2-30 „Medical electrical equipment - Part 2-30: Particular requirements for the basic safety and essential performance of automated type non-invasive sphygmomanometers“.

Drahtlose Kommunikation: VZ (MURATA Manufacturing Co. Ltd.)
Bluetooth Ver.4.OLE BLP
Frequenzband: 2402-2480 MHz
Maximale RF Ausgangsleistung: 1.6dBm
Modulation: GFSK

Prüfanweisung für die messtechnische Kontrolle

(nur für geschultes Fachpersonal)



Die messtechnische Kontrolle – spätestens alle 2 Jahre – ist durchzuführen von folgenden Einrichtungen oder Personen:

- Hersteller
- für das Messwesen zuständige Behörde
- Personen, welche die Voraussetzungen der Medizinprodukte-Betreiberverordnung erfüllen.

A) Funktionsprüfung

Eine Funktionsprüfung des Gerätes kann nur am Menschen oder mit einem geeigneten Simulator durchgeführt werden.

B) Prüfung auf Dichtheit des Druckkreises und Abweichung der Druckanzeige

Hinweise:

- a) Wenn der Druck im Messmodus über 299 mmHg gesteigert wird, spricht das Schnellablassventil an und öffnet den Druckkreis. Wenn der Druck im Prüfmodus über 320 mmHg gesteigert wird, blinkt die Messwertanzeige.
- b) Für die Prüfung ist ein spezieller Prüfstecker zu verwenden. Der Prüfstecker ist kostenpflichtig beim Hersteller erhältlich.
In den Druckkreis ist zusätzlich ein Pumpball einzufügen.

Prüfanweisung für die messtechnische Kontrolle

(nur für geschultes Fachpersonal)

Prüfung

- 1.) Batterien entnehmen.
- 2.) START-Taste gedrückt halten und Batterien einsetzen.
- 3.) START-Taste loslassen.
Das Gerät befindet sich jetzt im Prüfmodus; in den Feldern SYS und DIA wird der aktuelle Druck angezeigt.
- 4.) Prüfung auf Abweichung der Druckanzeige und Dichtheit des Druckkreises (Setzzeit der Manschette – mindestens 30 s – beachten) in der üblichen Weise durchführen.
- 5.) Gerät durch erneutes Drücken der START-Taste ausschalten.



⚠ Service und Wartung dürfen nicht durchgeführt werden, während das Gerät benutzt wird.

Table of contents

Product features	52
Contents of package	53
Symbols on the blood pressure monitor and in the app	54
Symbols on the power supply unit	57
Quick guide	58
Introduction	59
Purpose	60
Blood pressure values	61
Systolic and diastolic blood pressure value	61
WHO blood pressure cut-off values	61
Starting up	63
Inserting batteries	63
Battery status	64
General instructions for self-measurement	65
General Notices for Bluetooth Connection	67
Preparing to measure your blood pressure	69
Note on cuff sizes	69



Table of contents

Attaching the cuff	70
Measuring your blood pressure	73
Interrupting a measurement	74
Measurement display	75
Set up app and create connection	77
Measuring and transferring blood pressure	81
Evaluating and sending measurements	83
Deleting measurement values	85
Mains operation	86
Error messages	87
Cleaning and Disinfection	90
Warranty Conditions	91
Customer service / Disposal	92
Technical data	93
Calibration checks - Testing instructions (for trained specialist staff only)	96



Product features



Contents of package

1 boso medicus system
blood pressure monitor



4 LR 6 (AA) batteries



1 CA 04 universal cuff



1 User
instructions



1 Bag



Symbols on the blood pressure monitor

Symbol	Function/meaning
	START/STOP button
	Direct current
	Serial number
	Year of manufacture
	Type BF: The device, cuff and tubing have been designed to protect the patient against electric shock.
	Bluetooth communication active.
	MR eading in progress. Flashes as soon as a heartbeat was detected.

Symbols on the blood pressure monitor

Symbol	Function/meaning
	Cardiac rhythm disorder or movement during reading.
	Battery fully charged.
	Battery partly discharged.
	Replace battery as soon as possible.
	Flashing! No further reading possible. Replace battery.
	Protect against liquids

(EN)

Symbols on the blood pressure monitor and in the app

Symbol	Function/meaning
SYS	Systolic blood pressure in mmHg
DIA	Diastolic blood pressure in mmHg
PUL	Pulse per minute
Arr	Reading with cardiac rhythm disorder or movement
CE 0124	Device complies with the European Medical Devices Directive.
	Device must not be discarded with household waste.
	Manufacturer
	Read instructions for use
	Polarity of power supply port

Symbols on the power supply unit

Symbol	Function/meaning
	Only for use in enclosed spaces.
	Protection class II device
	Thermal fuse
	Fuse
	Device complies with the European Medical Devices Directive
	Polarity of the mains adapter plug

EN

Quick guide

- ▶ Insert batteries, ensure correct positioning (P. 63)
- ▶ Connect cuff to monitor (P. 69)
- ▶ Attach cuff (P. 70)
- ▶ Start (and stop) a measurement by pressing the start button (P. 73)

Measured systolic, diastolic and pulse values are displayed after the measurement is completed (P. 75)

 This quick guide does not replace the detailed information on the use and safety of the blood pressure monitor featured in the user instructions.



Please be sure therefore to read the user instructions!

Introduction

Dear Customer,

We are delighted that you have decided to purchase a boso blood pressure monitor. The boso brand is synonymous with optimal quality and precision and is also number 1 among professionals: 96% of all German general practitioners, physicians and internists work in practice with blood pressure instruments from boso (API survey conducted by GfK 01/2016). The experience gained from decades of use by professionals has also been incorporated into all the patient monitors for home measurement.

This instrument has also passed our strict quality control procedures and is your reliable partner for monitoring your blood pressure values.



Please read these user instructions

before using the instrument for the first time, as correct blood pressure readings can only be obtained if the instrument is operated correctly.

In these user instructions, „“ means an action by the user.

EN

To get help concerning usage or maintenance please contact your dealer or the manufacturer (contact details can be found on the back cover of this manual).

An unexpected operating condition or an incidence which has worsened the health condition or could have worsened the health condition should be reported to the manufacturer immediately.

If the instrument is to be sold, ensure that these user instructions are enclosed.

Introduction

The boso-medicus system blood pressure monitor is suitable for patients with an upper arm circumference of between 22 and 48 cm.

The use of accessories not referred to in these instructions for use can undermine safety.

Wireless communication devices, such as home networking devices, mobile phones, cordless phones and their base stations, walkie-talkies can affect this blood pressure monitor. Therefore, a minimum distance of 12 inch should be kept from such devices.

The Bluetooth radio transmission of the device conforms to the Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU.

Purpose

Non-invasive recording of systolic and diastolic blood pressure and pulse rate in adults. Not suitable for use on newborn babies and infants. The device is suitable for self-measurement at home. The patient is regarded as the operator.

The instrument can be used with any arm circumference as shown on the corresponding cuff.

EN

Blood pressure values

To determine the blood pressure, **two values** need to be measured:

- **Systolic (upper) blood pressure:**

This is produced when the heart muscle contracts and blood is forced into the blood vessels.

- **Diastolic (lower) blood pressure:**

This is present when the heart muscle expands and fills with blood again.

Blood pressure measurement values are expressed in mmHg (mm of mercury).

(EN)

The World Health Organization (WHO) has defined the following cut-off values for assessing blood pressure:

	systolic	diastolic
High blood pressure (hypertension)	over 140 mmHg	over 90 mmHg
Borderline normal blood pressure	130 to 139 mmHg	85 to 89 mmHg
Normal blood pressure	120 to 129 mmHg	80 to 84 mmHg
Optimum blood pressure	up to 119 mmHg	up to 79 mmHg

Blood pressure values

Whether medical treatment is necessary depends not only on the blood pressure, but also on the patient's risk profile. Please contact your GP if one of the values (systole, diastole) consistently exceeds the cut-off point for high blood pressure.

EN

Self-measurement of blood pressure often produces somewhat lower values at home

than at the doctor's. The German Hypertension League has therefore defined lower cut-off values for home measurements:

Home measurement:	135/85 mmHg
Measurement in the doctor's surgery:	140/90 mmHg

Starting up

The device must be installed and put into operation in accordance with the instructions in this manual.

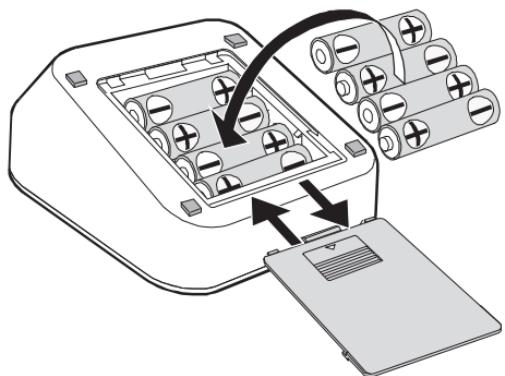


Illustration 1

- Use only high quality leak-proof batteries of the correct specifications (see "Technical data" P. 93).

⚠ Never mix old and new batteries or different makes.

⚠ If the batteries are not inserted correctly, the monitor will not work and this may cause the batteries to heat up and leak, damaging the monitor.

(EN)

→ Inserting the batteries

The battery compartment is located on the underside of the monitor. Insert batteries in the battery compartment as shown in illustration 1.

- Remove the batteries if the monitor is not to be used for any length of time.

⚠ Batteries that are short-circuited can become hot and cause burning.

Starting up

The monitor has a battery status display
(see P. 55)

-  Battery fully charged.
-  Battery partially charged.
-  Replace battery soon.
-  Flashing! No further measurements possible.
Replace battery.

EN



Care for the environment

Do not dispose of used batteries and charger units in domestic waste. You can take these to collection sites for used batteries or special waste. Contact your local authority for information.

General instructions for self-measurement

1. Fluctuations in blood pressure are quite normal. Even when measurements are repeated, there can be marked differences. Single or irregular measurements do not provide reliable information about the actual blood pressure. A reliable evaluation is only possible if regular measurements are taken under comparable conditions and the measurement values entered in the blood pressure record card.
2. **⚠️ Self-testing does not mean self-treatment. Do not on **any** account change the dose of medicine prescribed by your doctor of your own accord.**
3. Irregular heartbeats can affect the accuracy of the monitor or result in incorrect measurements (see page 88).
4. Incorrect measurements can also occur in patients with a weak pulse (possibly in patients wearing a pacemaker, for example). The blood pressure monitor itself has no effect on the pacemaker.
5. The device has not been validated for use on pregnant women.
6. Always take the measurement in a calm and relaxed state.
You are recommended to check your blood pressure twice a day – in the morning on getting up and in the evening once you have relaxed after work.
7. Always measure your blood pressure from the arm with the higher blood pressure values (where not required otherwise (see page 71)).



General instructions for self-measurement

To do this, measure the blood pressure first in both arms and thereafter always from the arm with the higher blood pressure.



General Notices for Bluetooth Connection

-  The blood pressure monitor may not be used in locations where wireless communication is prohibited, such as in aircraft or hospitals. This blood pressure monitor can have unfavorable effects on electronic devices or electrical medical devices.
- The maximum communication distance between the blood pressure monitor and the receiver equals approx. 10 meters. This distance can be reduced by the environment; therefore, verify whether the distance is short enough for transmission of data after the measurement.
- Ensure that the space between the blood pressure monitor and the mobile device is unobstructed. The communication distance can be shortened by the construction of the building or other obstacles. Communication through reinforced concrete walls in particular may not be possible under certain circumstances.
- During pairing, Bluetooth must be deactivated on all other devices within range.
- If the improbable case should occur that this blood pressure monitor disrupts other wireless communication devices, use the blood pressure monitor at a different location.

EN

General Notices for Bluetooth Connection

- Do not use the Bluetooth connection in the vicinity of an IEEE802.11g/b/n-WLAN device or other wireless communications systems (particularly in the range of 2.4 GHz) or near devices which emit electromagnetic waves (such as microwave appliances). This can cause the connection to be frequently interrupted, communication speed to be significantly reduced and errors to occur.

EN

Preparing to measure your blood pressure


Note on cuff sizes:

⚠ The monitor may only be used with the following cuff types. These should be chosen according to the upper arm circumference printed on them.

Type	Arm circumference	Order number
CA01	22 – 32 cm	143-4-764
CA02	32 – 48 cm	143-4-757
CA04	22 – 42 cm	143-4-765*

* Standard cuff supplied as standard.

Attach the cuff to the monitor by pressing the plug (click) into the socket on the left side of the unit. (See illustration 2).

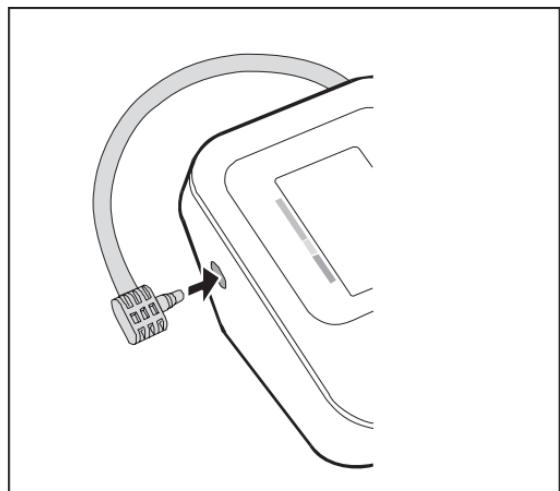

EN

Illustration 2

Preparing to measure your blood pressure

Observe the following instructions when measuring your blood pressure:



Avoid smoking or drinking coffee for one hour before measuring your blood pressure.



Sit comfortably for the blood pressure measurement. Support your back and arms. Do not cross your legs. Place your feet flat on the floor.

Relax for 5 minutes before taking a measurement.

Do not move during the measurement.

Attaching the cuff

The measurement should be taken from the bare upper arm.

⚠ In the case of tightly fitting outer clothing, ensure that the blood supply to the arm is not cut off when the sleeve is rolled up (if necessary remove the article of clothing before taking the measurement).

→ Open out the cuff into the shape of a ring and slide it over the upper arm until the bottom edge of the cuff is about 2-3 cm above the elbow. The cuff must be positioned so that the marking is over the artery (see illustration 3).

Preparing to measure your blood pressure

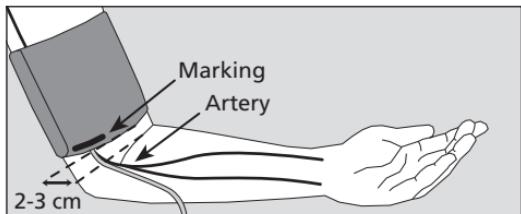


Illustration 3

⚠ Do not attach the cuff over wounds as this can cause further injuries.

⚠ Ensure that the cuff is not attached to an arm where arteries or veins are undergoing or have undergone medical treatment (e.g. shunt).

⚠ For women who have had a breast amputated, do not attach the cuff to the arm on the amputated side of the body.

⚠ During the measurement, medical apparatus that are being used on the same arm at the same time, may malfunction.

⚠ The cuff must not be too tight. There should be enough space to fit roughly two fingers between arm and cuff.

⚠ The metal ring should **never** lie over the artery (see illustration 3) as this may produce a false reading.

→ Grasp the end of the cuff that feeds through the metal ring and wrap it around the outside of your arm. Attach the Velcro fastener by applying gentle pressure.

EN

Preparing to measure your blood pressure

- Place your arm with the cuff attached on the table, holding it relaxed and slightly bent so that the cuff is level with your heart.

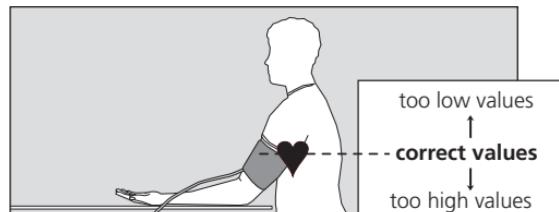


Illustration 4

-  Do not talk during the measurement.

! Check that the air tube is not kinked during the measurement. This could cause congestion of the blood flow and subsequent injury.

! The blood pressure measurement should not prevent the flow of blood for an unnecessary length of time (> 2 minutes). If the monitor fails to function correctly, remove the cuff from the arm.

! Excessive frequent measurements can cause injury by restricting blood flow.

! The device may not be used by unsupervised children.

! Do not use the device near infants. This can lead to accidents or damage.

! Do not start the device without putting on the cuff.

! There are small parts that may cause a choking hazard if swallowed by mistake by infants.

⚠ If the ambient temperature changes significantly, leave the device about an hour to adapt to the new ambient temperature before using it.

⚠ The performance of the device can be affected by excessive temperature, humidity or altitude.

Measuring your blood pressure

- Start the measurement with the start button



⚠ Now hold the arm absolutely still and do not talk.

All the items on the LCD display appear briefly to indicate that the monitor is now ready for use (see illustration 5).

(EN)

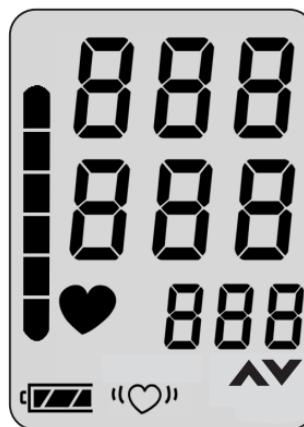


Illustration 5

Measuring your blood pressure

The pump starts to inflate the cuff.

The monitor has an intelligent automatic inflation system for gentle inflation to the correct cuff pressure.

The rising cuff pressure is displayed as a digital numerical value and in the form of a bar on the left-hand edge of the display.

When the **required pressure** is reached, the pump switches off and the air is released slowly from the cuff.

⚠ Interrupting a measurement:

A measurement can be interrupted at any stage by pressing the start button; the cuff deflates automatically.

During the measurement phase the descending cuff pressure and the flashing  symbol are displayed (see illustration 6).



Illustration 6

Measurement display

After the end of the measurement, the in-built valve opens automatically and the cuff deflates rapidly.

The measured blood pressure values (systole, diastole, pulse) are displayed (see illustration 7).



Illustration 7

If the symbol “(“) appears after the measurement, it is recommended that the measurement is repeated, holding the arm completely still. If the “(“) symbol appears again even with the arm held still, this may be an indication of an irregular heartbeat. Please discuss this with your doctor at your next visit.

(EN)

Blood pressure is a dynamic parameter and can be affected by the patient's position, e.g. sitting, standing, lying, moving, before or during the measurement, physical condition (stress, disease, etc.).

► If the measurement result is obviously wrong, repeat the measurement.

Measurement display

The unit switches itself off automatically after about 1 min. To repeat a measurement, press the start button again **briefly**.



Allow at least two minutes between measurements.

- If no further measurement is required, remove the cuff from the arm.

EN

Set up app and create connection



Requires interaction with boso-App



Requires interaction with boso medicus system

- Download the boso app from the Google/Apple Store.



To enable data exchange between the blood pressure monitor and your mobile device, follow these steps:



- Ensure that Bluetooth is activated on your mobile device. (Bluetooth 4.0 is required)

When installing the app, the operating system (Android/iOS) will ask for permission to access the current location.

You must answer "YES" in order to avoid BT connection errors.

Note: The information "current location" is not required by the boso app but by the operating system for the Bluetooth connection.

Set up app and create connection



- Open the boso app on your mobile device.
- Set up a new user:
 1. Select “User” from the main menu.
 2. Select “+New” from the bottom menu bar.
 3. Enter your personal data. Compulsory fields are indicated by “*”.
 4. Click on the “Save” button in the bottom menu bar to save the data you have entered.
- Tick the user for whom you wish to save the measurement values.

EN



Set up app and create connection



- Use the “Back” button in the top menu bar to return to the main menu.
- Open “Devices” in the main menu.



- Press the START key on the blood pressure monitor and hold it down until “Pr” appears on the display. The communication indicator is shown on the display for approximately one minute.
- In the “Devices” menu, select “Add new device” in the bottom menu bar.



If you are using iOS, you must also press “Pair” to confirm the pairing request.



- Date and time are automatically synchronised by the mobile device.



- After pairing successfully, “End” appears in the display on the monitor and the monitor is displayed in the device list in the app.



Setup is now complete. Now leave the menu via the “Back” button in the top menu bar.

Set up app and create connection

The blood pressure monitor must be reconnected to the mobile device **after changing the batteries**, as the time information is deleted when the batteries are changed.

If this is not done, the current system time of the mobile device is stored as the time stamp for the readings during data transfer.

Please proceed as follows:

- Delete the blood pressure monitor from the devices list in the app
- Delete the blood pressure monitor from the Bluetooth settings of the mobile device
- Pair again as described.

EN

Measuring and transferring blood pressure

Now put on the cuff and carry out a blood pressure measurement as described in the user instructions.



As long as Bluetooth is active and the app is running, the measured values are automatically transferred after the blood pressure measurement has been completed.



After successful transfer, the measurement value is deleted from the measurement value memory of the blood pressure monitor.



Repeat the pairing process if the measurement data have not been transferred. If the app or Bluetooth are inactive, up to 30 measurement

values are automatically saved in the blood pressure monitor (If the measurement value memory of 30 measurements is full, the oldest measurement is deleted and the current measurement is saved. Faulty measurements are not saved) and sent after the next measurement once the app has been activated.

EN


In order to enable all saved measurement values in the medicus system measurement value memory to be transferred to the app, measurement value transfer of all measurement values must be activated in the "Settings" menu (default setting). If "last" is selected here,

Measuring and transferring blood pressure

only the last measured measurement value is transferred and all saved measurement values are deleted.

Times for the morning and afternoon evaluations can also be altered in this menu.

Save your settings by using the "Save" button in the bottom menu bar.

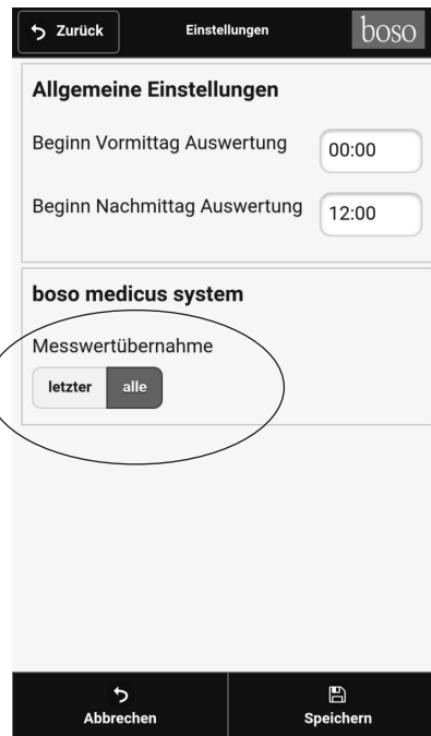

Evaluating and sending measurements




All measurement values that have been sent so far are displayed in the "Measurement values" menu.

Use the "Graphs" button in the bottom menu bar to see a graphic representation of the measurement values.

The buttons in the top area of the screen allow you to select the graphs available: "SYS/DIA" and "PULSE". Click on a graph to enlarge or shrink it.

"kg/BMI" is intended for scales.

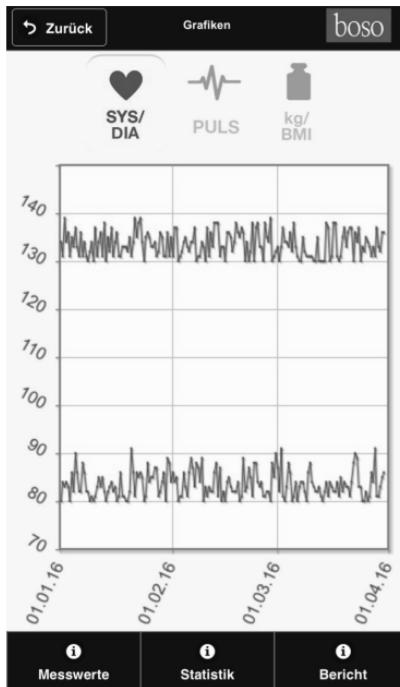

Evaluating and sending measurements



Use the "Statistics" button in the bottom menu bar to see a statistical summary of the measurement values. The time range for the summary (date from/to) can be selected.

The "Report" button in the bottom menu bar takes you to the menu which you use to send measurement values. The summary can be sent by email in PDF or XML format.

The XML file can be imported into the PC program "boso profilemanager XD Home." This program offers additional evaluation options and is available free of charge from the Internet

([http://www.boso.de/download/
profilmanagerXDHome/](http://www.boso.de/download/profilmanagerXDHome/)).

EN

A screenshot of a software window titled 'Bericht'. The top bar includes a 'Zurück' (Back) button, the title 'Bericht', and the 'boso' logo. Below the title are two input fields: 'An:' (To:) and 'Kopie:' (Cc:), each with a search icon. Underneath these is a section labeled 'Email Text:' containing a large text area. At the bottom are two buttons: 'Als XML senden' (Send as XML) and 'Als PDF senden' (Send as PDF).

Zurück Bericht boso

An:

Kopie:

Email Text:

Als XML senden Als PDF senden

Deleting measurement values



Individually selected measurement values or measurement data older than 1/3/6/12 months can be deleted via the "Delete" button in the bottom menu bar.

Note that data cannot be restored. Please archive your data in good time by creating an XML or PDF file using the "Report" button.



The screenshot shows a smartphone displaying a list of blood pressure measurements. The top bar includes a back button, a "Zurück" button, and the text "Messwerte Max Mustermann". The data table has columns for date/time, systolic pressure (SYS), diastolic pressure (DIA), pulse (PUL), and heart rate (Arr). Each row also features a small square icon with a minus sign, indicating it's a delete button. The data entries are:

	SYS	DIA	PUL	Arr	kg	
17.10.2018 11:09:00	-	-	-	-	85	
30.03.2016 18:00:00	136	86	66	-	-	
30.03.2016 08:00:00	-	-	-	-	78,5	
30.03.2016 08:00:00	136	85	68	-	-	
29.03.2016 18:00:00	-	-	-	-	78,8	
29.03.2016 18:00:00	132	83	67	-	-	
29.03.2016 08:00:00	-	-	-	-	78,7	
29.03.2016 08:00:00	133	81	65	-	-	
28.03.2016	-	-	-	-	78,9	

At the bottom, there is a navigation bar with icons for Statistik, Grafiken, Bericht, Eingabe Gewicht, and Löschen.

EN

Mains operation

The mains connection socket is located at the rear of the monitor.

Where required, use only the boso power supply unit (**order number 410-7-150**).

This power supply unit produces a rectified output of the correct polarity. Other commercially available power supply units can cause damage to the electronic components, which will invalidate the warranty. There is also a risk of fire with these other power supply units.

EN

 Do not touch the batteries, the power supply unit socket and the patient at the same time.

 Remove the power supply unit plug from the blood pressure monitor when it is not in use.

Error messages

If any problems occur during the measurement, the display will show an error message instead of a blood pressure reading.

Meaning of error messages:

Cause of Err message:	Troubleshooting:
	Excessive variation in cuff pressure during measurement Hold arm still.
No valid pulse readings	Check position of cuff (see page 70) and repeat measurement.
Systole – diastole difference too small: $Systole - diastole \leq 10 \text{ mmHg}$	Check position of cuff (see page 70) and repeat measurement.
	Incorrectly inflated Cuff possibly too loose, attach cuff more firmly (see page 70)

(EN)

Error messages

Cause of Err message: Troubleshooting:		
	The pulse value could not be determined correctly.	Check position of cuff and repeat measurement.
	Internal Error	Remove the batteries and briefly press START button. Put the batteries back into the monitor. If the error persists, return the instrument for repairs to the manufacturer.
		
	"♥" Display: Troubleshooting:	
	Repeat measurement recommended, holding the arm absolutely still. If the "♥" symbol appears again, even with the arm held still, this may be an indication of an irregular heartbeat. Please discuss this with your doctor at your next visit.	

Fehleranzeige

Cause of **Err** message: Troubleshooting:



Bluetooth connection
error

Remove the batteries and briefly press START button. Put the batteries back into the monitor. Carry out the pairing again. If the error persists, return the instrument for repairs to the manufacturer.



When installing the app, the system will ask for permission to access the current location. You must answer "YES" in order to avoid BT connection errors.

(EN)

Cleaning and Disinfection

Cleaning Monitor:

Use a soft, dry cloth to clean your monitor.

Cleaning Cuff:

Small stains on the cuff can be removed carefully with a proprietary washing-up liquid.

EN

Disinfection Cuff:

For disinfectant wipes (at least 5 minutes exposure time) of the device and the cuff, we recommend the disinfectant antifect liquid (Schülke & Mayr). To disinfect the cuff, we recommend spray disinfection.

In particular, if the device is used on multiple users is to pay attention to regular cleaning and disinfections of the cuff.

Warranty Conditions

We give 3 years warranty from the date of purchase. The purchase date has to be proven by the invoice. Within the warranty period defects are eliminated free of charge. After repairs the warranty period is not extended on the whole unit, but only to the replaced components.

Excluded from the warranty are parts subject to normal wear and tear (e.g. cuff), transport damages and any damage caused by improper handling (e.g. non-compliance with the instructions for use). Damages due to disassembly by unauthorized persons are also excluded from warranty.

No claims for damages against us are substantiated by the warranty.

In the case of justified warranty claims the device has to be sent along with the original invoice to:

BOSCH + SOHN GMBH U. CO. KG,
Bahnhofstr. 64, D-72417 Jungingen.

boso accepts no responsibility for losses, such as operational disruptions or data losses, which can occur due to the use of this blood pressure monitor.

No guarantee is made that this blood pressure monitor can establish a connection with all Bluetooth-compatible devices.



Customer service

EN

Customer service:

Warranty and repair work must be undertaken by trained and authorised personnel. Do not modify this equipment without authorization of the manufacturer.

Send the monitor, carefully packaged and with sufficient postage, to your authorised dealer or directly to:

BOSCH + SOHN GmbH u. Co. KG
Serviceabteilung
Bahnhofstraße 64, D-72417 Jungingen
T: +49 (0) 74 77 / 92 75-0

Disposal



Do not dispose of monitors and batteries in the domestic waste.

At the end of its lifespan, the monitor must be taken to a collection site for obsolete electronic items.

Please note that batteries and rechargeable batteries must be disposed of separately (local authority collection site).

Expected operational lifetime of the equipment: 5 years (using the unit 6 times a day).
Expected operational lifetime of the cuff: 2 years (using the unit 6 times a day).

Technical data

Measurement principle:	oscillometric
Measurement range:	Systolic: 60 to 279 mmHg Diastolic: 40 to 200 mmHg Pulse: 40 to 180 per minute
Cuff pressure:	0 to 299 mmHg
Memory store:	30 measurements
Display:	LCD
Operating conditions:	environmental temperature +10°C to +40°C Relative humidity 15 to 85% Air pressure 800 hPa to 1060 hPa
Transport/ Storage conditions:	environmental temperature –20°C to +60°C Relative humidity 10 to 95% Air pressure 700 hPa to 1060 hPa
Power supply:	DC 6 V (4 x 1.5 V Mignon IEC LR 6 alkaline manganese batteries) Alternative special option: DC 6 V power supply unit, Order No. 410-7-150



Technical data

Typical battery life:	500 measurement cycles (depending on inflation pressure and frequency of use).
Battery check:	symbol display in LCD window
Weight:	250 g without batteries
Dimensions (WxHxD):	96 mm x 68 mm x 130 mm
Classification:	Medical device with internal energy source (in battery operation) / class II (in power supply unit operation), continuous operation mode
Applied part:	Type BF (ⓘ)
Protection against solid objects:	IP20 IP classification is the degree of protection provided by enclosures in accordance with IEC 60529. This device is protected against solid foreign objects of 12mm diameter and greater such as fingers. This device is not protected against water.



Technical data

Clinical test:	Accuracy complies with the requirements of ISO 81060 Part 2
Bluetooth:	Bluetooth Version 4.0
Maximum deviation of cuff pressure measurement:	± 3 mmHg or 2% of the reading (whichever is greater)
Maximum deviation of pulse rate display:	± 5 %
Applicable standards:	DIN EN ISO 80601-2-30 „Medical electrical equipment - Part 2-30: Particular requirements for the basic safety and essential performance of automated type non-invasive sphygmomanometers”.
Wireless Communication:	VZ (MURATA Manufacturing Co. Ltd.) Bluetooth Ver.4.OLE BLP Frequency band: 2402-2480 MHz Maximum RF output power: 1.6dBm Modulation: GFSK



Calibration checks - Testing instructions

(for trained specialist staff only)

Calibration checks – every 2 years at the latest – must be performed by the following institutions or persons:

- Manufacturer
- Trade measurements authorities
- Persons who fulfil the requirements of the legislation governing the operation of medical devices.

A) Function testing

Function testing of the monitor can only be carried out on a person or with a suitable simulator.

B) Testing of pressure circuit integrity and deviation of pressure display

Note:

- a) When the pressure in measurement mode increases above 299 mmHg, the quick release valve is triggered and the pressure circuit opens. When the pressure in test mode increases above 320 mmHg, the measured value display flashes.
- b) For the calibration checks a special test plug must be used. The test plug is available for a fee from the manufacturer.
A pump ball must also be introduced into the pressure circuit.

Calibration checks - Testing instructions

(for trained specialist staff only)

Testing

- 1.) Remove batteries.
- 2.) Hold start button pressed down and insert batteries.
- 3.) Release start button.
The monitor is now ready for testing;
the current pressure is displayed in the
SYS and DIA fields.
- 4.) Perform test for deviation of pressure
display and pressure circuit integrity
(observe setting time for cuff – at least
30 seconds) in the usual manner.
- 5.) Switch off monitor by pressing the
START button again.



The device must not undergo service or maintenance while it is in use.



Table des matières

Présentation de l'appareil.....	100
Contenu de l'emballage.....	101
Symboles sur le tensiomètre et dans l'application.....	102
Symboles sur le bloc d'alimentation.....	105
Guide rapide d'utilisation.....	106
Introduction.....	107
Destination.....	108
Valeurs de la tension artérielle.....	109
Tensions artérielles systolique et diastolique.....	109
Valeurs limites de l'OMS pour l'analyse de la tension artérielle.....	109
Mise en service de l'appareil.....	111
Mise en place des piles.....	111
Témoin de charge des piles.....	112
Recommandations générales sur l'automesure de la tension artérielle.....	113
Indications générales sur la connexion Bluetooth.....	115
Préparation de la mesure de la tension artérielle.....	117
Recommandations relatives aux dimensions du brassard.....	117



Table des matières

Pose du brassard	118
Mesure de la tension artérielle	121
Interruption de la mesure	122
Affichage des valeurs mesurées	123
Installer l'application et établir la communication	125
Mesure de la tension et transfert des données	129
Évaluation et envoi des données	131
Suppression de mesures	133
Transmission des données sur l'application boso	134
Messages d'erreur	135
Nettoyage et désinfection	138
Conditions de Garantie	139
Service après-vente / Élimination	140
Caractéristiques techniques	141
Instructions relatives au contrôle technique de l'appareil (uniquement pour les techniciens formés)	144

FR

Présentation de l'appareil



Contenu de l'emballage

1 tensiomètre
boso medicus system



4 piles LR 6 (AA)



1 brassard standard
CA 04



1 mode d'emploi



1 étui



Symboles sur le tensiomètre

Symbole	Fonction/signification	
	Touche START/STOP	
	Courant continu	
	Numéro de série	
		Année de fabrication
	Type BF : le tensiomètre, le brassard et les tuyaux ont été développés de manière que le patient soit protégé contre les chocs électriques.	
	Communication Bluetooth activée.	
	Mesure en cours. Clignote dès qu'un battement de cœur a été détecté.	

Symboles sur le tensiomètre

Symbole	Fonction/signification
	Trouble du rythme cardiaque ou mouvement pendant la mesure.
	Batterie entièrement chargée.
	Batterie partiellement déchargée.
	Remplacer prochainement la batterie.
	Clignotant ! Une mesure n'est plus possible. Remplacer la batterie.
	Craint l'humidité

FR

Symboles sur le tensiomètre et dans l'application

Symbole	Fonction/signification
SYS	Pression systolique en mmHg
DIA	Pression diastolique en mmHg
PUL	Nombre de battements par minute
Arr	Mesure avec trouble du rythme cardiaque ou mouvement
0124	L'appareil est conforme à la directive européenne « Dispositifs médicaux ».
	L'appareil ne doit pas être jeté à la poubelle.
	Fabricant
	Lire le mode d'emploi
	Polarité de la prise du bloc d'alimentation

Symboles sur le bloc d'alimentation

Symbole	Fonction/signification
	À utiliser uniquement dans des locaux fermés.
	Appareil de la classe de protection II
	Fusible thermique
	Fusible
	L'appareil est conforme à la directive européenne « Dispositifs médicaux ».
	Polarité du connecteur de l'adaptateur secteur

FR

Guide rapide d'utilisation

- ▶ Insérez les piles en respectant la polarité (page 111).
- ▶ Reliez le brassard à l'appareil (page 117).
- ▶ Posez le brassard (page 118).
- ▶ Appuyez sur la touche Marche pour lancer/arrêter une mesure (page 121).

Les valeurs de la systole, de la diastole et du pouls sont affichées après la mesure (page 123).

! Ce guide rapide d'utilisation ne remplace pas les informations détaillées contenues dans le mode d'emploi et relatives à l'utilisation et à la sécurité de votre tensiomètre.



Veuillez lire attentivement le mode d'emploi !

FR

Introduction

Cher client, chère cliente, félicitations pour l'achat de ce tensiomètre boso. La marque boso, synonyme de qualité et précision, est aussi numéro 1 chez les professionnels. 96% de tous les médecins généralistes, praticiens et spécialistes de médecine interne allemands utilisent des sphygmomanomètres boso dans leur cabinet (étude API de la GfK, 01/2016). Chaque appareil boso destiné à l'automesure profite d'un savoir-faire de plusieurs décennies dans le domaine professionnel. Cet appareil qui a subi un contrôle qualité rigoureux est un outil sûr de contrôle de la tension artérielle.

⚠️ Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant la première utilisation. Une utilisation conforme de l'appareil est

indispensable pour garantir une mesure correcte de la tension artérielle.
Dans ce mode d'emploi, le symbole « ➔ » indique une action de l'utilisateur.

Pour obtenir de l'aide relative à la mise en service, l'utilisation ou la maintenance, veuillez vous adresser à votre revendeur ou au fabricant (les coordonnées figurent sur la quatrième de couverture de ce mode d'emploi).

FR

En cas d'incident ou d'état de fonctionnement inattendu qui a altéré l'état de santé ou qui aurait pu altérer l'état de santé, le constructeur devra immédiatement être averti.

Ce mode d'emploi doit être joint en cas de cession de l'appareil.

Introduction

Le tensiomètre boso-medicus system est adapté aux patients dont le tour de bras se situe entre 22 et 48 cm.

L'utilisation d'accessoires non mentionnés dans ce mode d'emploi peut être préjudiciable à la sécurité.

Des appareils de communication sans fil, tels que appareils réseau domestiques sans fil, téléphones portables, téléphones sans fil et leurs stations de base, des talkies-walkies peuvent affecter ce moniteur de pression artérielle. Par conséquent, une distance minimale de 30 cm doit être maintenue pour de tels dispositifs.

La radio transmission Bluetooth de l'appareil répond aux exigences de la directive équipements radioélectriques 2014/53/EU.



Destination

Mesure non-invasive de la pression systolique et diastolique et de la fréquence chez les adultes. Ne convient pas pour une utilisation chez les nouveau-nés et les petits enfants. L'appareil convient pour une automesure à domicile. L'utilisateur prévu est le patient.

Le tensiomètre est conçu pour tous les tours de bras comme indiqué sur le bras-sard.

Valeurs de la tension artérielle

Pour obtenir la tension artérielle, **deux valeurs** doivent être mesurées :

- **la tension artérielle systolique (supérieure) :**

Elle apparaît lors de la contraction du muscle cardiaque qui entraîne l'éjection du sang dans les vaisseaux sanguins.

- **Tension artérielle diastolique (inférieure) :**

Elle apparaît lors de la dilatation du muscle cardiaque qui se remplit de nouveau de sang.

Les valeurs mesurées de la tension artérielle sont indiquées en mmHg (millimètres de mercure).

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a défini les valeurs limites suivantes pour la classification de la tension artérielle :

	Systolique	Diastolique
Tension trop haute (hypertonie)	> 140 mmHg	> 90 mmHg
Tension normale - haute	130 à 139 mmHg	85 à 89 mmHg
Tension normale	120 à 129 mmHg	80 à 84 mmHg
Tension optimale	jusqu'à 119 mmHg	jusqu'à 79 mmHg



Valeurs de la tension artérielle

Lorsqu'un traitement médicamenteux est nécessaire, la tension artérielle n'est pas le seul élément à prendre en compte ; il y a aussi le profil de risque du patient. Veuillez consulter votre médecin si une seule des valeurs (systolique, diastolique) est en permanence au-delà des valeurs limites, signalant une haute tension.

L'automesure de la tension fournit souvent des valeurs légèrement inférieures à celles mesurées dans le cabinet médical par le médecin. C'est pourquoi la Ligue allemande d'hypertension a défini des valeurs plus basses pour l'automesure :

Mesure au domicile :	135/85 mmHg
Mesure au cabinet médical :	140/90 mmHg



Mise en service de l'appareil

L'appareil doit être installé et mis en service selon les informations contenues dans ce manuel.

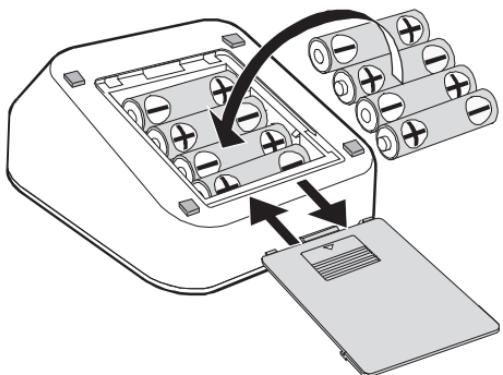


Figure 1

→ Utilisez uniquement des piles étanches de qualité et conformes aux spécifications (voir « Caractéristiques techniques », page 141).

⚠ Ne mélangez **jamais** d'anciennes piles avec de nouvelles piles ou des piles de types différents.

⚠ En cas de polarité incorrecte, l'appareil ne fonctionne pas et un dégagement de chaleur est possible ou alors les piles fuient et entraînent la détérioration de l'appareil.

→ Mise en place des piles

Le compartiment à piles se trouve sur la face inférieure de l'appareil. Insérez les piles comme sur la figure 1 dans le compartiment à piles.

→ Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, retirez les piles.

⚠ Si un court-circuit se produit dans les batteries, elles peuvent chauffer et provoquer des brûlures.

FR

Mise en service de l'appareil

L'appareil est doté d'un témoin de charge des piles (voir page 103).

-  Piles totalement chargées.
-  Piles partiellement usées.
-  Les piles doivent être bientôt remplacées.
-  Clignotant ! Aucune mesure n'est possible. Remplacer les piles.

Contribuez au respect de l'environnement

Les piles et batteries usées ne sont pas des ordures ménagères.

Il s'agit de déchets spéciaux qui doivent être rapportés aux points de collecte prévus.

Pour en savoir plus, adressez-vous à la mairie de votre localité.

FR

Recommandations générales sur l'automesure de la tension artérielle

1. Les variations de la tension artérielle sont normales. D'importantes différences sont également possibles lors de la répétition d'une même mesure. Des mesures uniques ou irrégulières fournissent des données peu fiables sur la tension artérielle réelle. Une appréciation fiable est possible uniquement lorsque vous réalisez les mesures dans des conditions similaires et que vous notez les valeurs mesurées dans le carnet de suivi.
2.  L'automesure n'est pas synonyme de thérapie. Ne modifiez **jamais** vous-même les posologies prescrites par votre médecin.
3. Des troubles du rythme cardiaque peuvent avoir un impact sur la précision de mesure de l'appareil, voire entraîner des mesures erronées (voir page 136).
4. Chez les patients présentant un faible pouls (notamment en cas de stimulateur cardiaque par exemple), des erreurs de mesure sont possibles. Le tensiomètre n'interfère pas sur le fonctionnement du stimulateur cardiaque.
5. L'appareil n'a pas été validé pour une utilisation chez les femmes enceintes.
6. La mesure doit toujours avoir lieu au repos. Il est recommandé de contrôler la tension artérielle deux fois par jour – le matin au lever et le soir après s'être reposé des fatigues de la journée.

FR

Recommandations générales sur l'automesure de la tension artérielle

7. La tension artérielle (sauf contre-indication, voir page 119) se mesure toujours au bras présentant les valeurs les plus élevées. Mesurez la tension artérielle d'abord aux deux bras, puis au bras dont la tension est la plus élevée.

FR

Indications générales sur la connexion Bluetooth

- **⚠️** L'appareil de mesure de la tension ne doit pas être utilisé dans des lieux où la communication sans fil est interdite, comme par ex. dans les avions ou les hôpitaux. Cet appareil de mesure de la tension peut avoir des effets indésirables sur les appareils électroniques ou les appareils médicaux électriques.
- La distance maximale de transmission entre l'appareil de mesure de la tension et le receveur est de 10 mètres. Cette distance peut être moindre en fonction du cadre alentours ; vérifiez donc que la distance pour la transmission des données après la mesure est suffisamment faible.
- Faites attention à ce que l'espace entre l'appareil de mesure de la tension et l'appareil mobile ne soit pas isolé. La distance de communication peut être réduite suivant le type de construction du bâtiment. Notamment, il se peut que la transmission à travers des murs en béton armé, etc. ne soit pas possible.
- Pendant la connexion, tous les autres appareils Bluetooth situés à portée de signal doivent être désactivés.
- Dans le cas peu probable où l'appareil de mesure de la tension perturberait d'autres appareils de transmission sans fil, utilisez l'appareil de mesure de la tension dans un autre lieu.



Indications générales sur la connexion Bluetooth

- N'utilisez pas la connexion Bluetooth à proximité d'un appareil Wifi IEEE802.11g/b/n ou d'un autre système de transmission sans fil (notamment dans la zone de 2,4 GHz) ou à proximité d'appareils émettant des ondes électromagnétiques (par ex. des appareils à micro-ondes). Cela pourrait provoquer des coupures répétées de la connexion, une vitesse de transmission bien plus basse et des erreurs.

FR

Préparation de la mesure de la tension artérielle


Recommandations relatives aux dimensions du brassard :

⚠ L'appareil peut être utilisé avec les brassards suivants uniquement. Ces derniers doivent être choisis en fonction du tour de bras indiqué.

Modèle	Tour de bras	N° de référence
CA01	22 – 32 cm	143-4-764
CA02	32 – 48 cm	143-4-757
CA04	22 – 42 cm	143-4-765*

* L'appareil est fourni avec un brassard standard.

Fixez le brassard à l'appareil en introduisant l'embout (clic) dans l'orifice situé sur le côté gauche de l'appareil (voir figure 2).

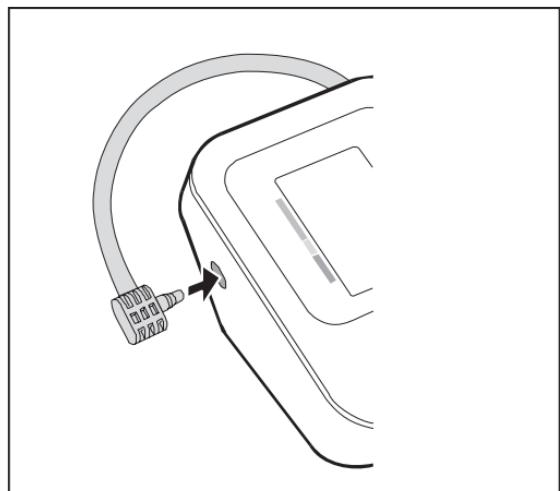

FR

Figure 2

Préparation de la mesure de la tension artérielle

Les instructions suivantes doivent être respectées lors de la mesure de la tension artérielle :



Évitez de consommer de la nicotine ou du café une heure avant la mesure de la tension artérielle.



Veillez à adopter une position assise confortable. Adossez-vous et posez les bras sur la table. Ne croisez pas vos jambes. Posez les pieds à plat sur le sol.

Détendez-vous pendant 5 minutes avant de réaliser la mesure. Ne bougez pas pendant la mesure.

Pose du brassard

La mesure doit être réalisée sur le bras supérieur dénudé.



Si vous portez un vêtement étroit, vérifiez que le bras n'est pas comprimé sous la manche relevée (si nécessaire, retirez le vêtement avant la mesure).

→ Passez le brassard ouvert en forme d'anneau sur le bras jusqu'à ce que le bord inférieur du brassard se trouve à environ 2-3 cm du coude. Positionnez le brassard de manière à aligner le repère avec l'artère (voir figure 3).

Préparation de la mesure de la tension artérielle

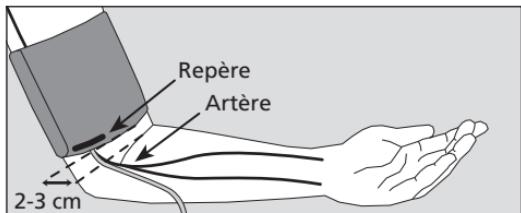


Figure 3

⚠ Le brassard ne doit pas être posé sur des plaies, car il pourrait entraîner d'autres blessures.

⚠ Vérifiez que le bras sur lequel est posé le brassard ne présente aucune artère ni veine en traitement médical présent ou passé (exemple : shunt).

⚠ Chez les femmes qui ont subi une amputation de la poitrine, le brassard ne doit pas être posé sur le côté amputé.

⚠ Pendant la mesure, des dysfonctionnements peuvent apparaître sur les appareils médicaux utilisés simultanément sur le même bras.

⚠ Le bras ne doit pas être trop comprimé. L'espace entre le bras et le brassard doit permettre de passer deux doigts.

⚠ La boucle métallique ne doit **jamais** reposer sur l'artère (voir figure 3) car il pourrait en résulter des mesures erronées.

→ Tirez l'extrémité du brassard insérée dans la boucle et rabattez-la vers l'extérieur autour du bras. Une légère pression permet de faire adhérer la bande Velcro.

FR

Préparation de la mesure de la tension artérielle

- Posez le bras avec le brassard de manière détendue et légèrement incliné sur la table : le brassard doit se trouver à hauteur du cœur.

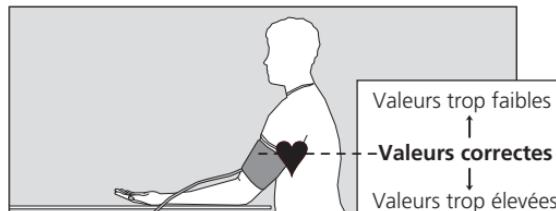


Figure 4



Ne parlez pas pendant la mesure de la tension.

- ⚠ Le flux sanguin ne doit pas être interrompu trop longtemps par la mesure de la tension artérielle (> 2 minutes). En cas de

dysfonctionnement de l'appareil, retirez le brassard du bras.

⚠ Des mesures trop fréquentes sont mauvaises pour la circulation sanguine et peuvent entraîner des lésions.

⚠ L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants s'ils ne sont pas surveillés.

⚠ Ne pas utiliser l'appareil à proximité de nourrissons. Cela peut entraîner des accidents ou des dommages.

⚠ Ne pas démarrer l'appareil sans mettre le brassard.

⚠ Il y a de petites pièces qui peuvent causer un risque d'étouffement si elles sont avalées par des nourrissons.

⚠ En cas de variation importante de la température ambiante, attendre environ une heure avant d'utiliser l'appareil afin qu'il s'adapte à la nouvelle température ambiante.

⚠ Une température, une humidité ou une altitude excessives peuvent influer sur les performances de l'appareil.

Mesure de la tension artérielle

- Démarrez la mesure en appuyant sur la touche Marche



⚠ Immobilisez totalement votre bras et ne parlez pas.

Pour un essai de fonctionnement, tous les organes de l'afficheur LCD s'affichent brièvement (voir figure 5).

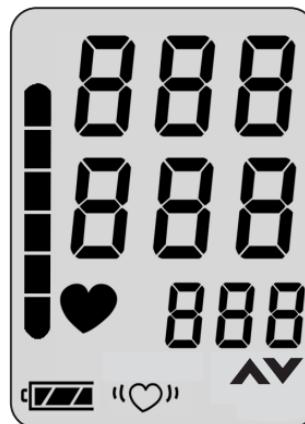


Figure 5

FR

Mesure de la tension artérielle

La pompe commence à remplir le brassard. L'appareil présente une fonction de gonflement automatique et intelligente qui garantit une montée en pression adaptée. La pression croissante du brassard est montrée sous forme numérique et sous forme de barres sur le bord gauche de l'écran.

Lorsque la **pression requise** est atteinte, la pompe se désactive et l'air se libère doucement du brassard.

FR

⚠ Interruption de la mesure :

Une mesure peut être interrompue à tout moment lorsque vous appuyez sur la touche Marche au cours d'une mesure. Le brassard se dégonfle alors automatiquement.

Pendant la phase de mesure, la baisse de la pression du brassard et le symbole ❤ clignotant sont affichés (voir figure 6).



Figure 6

Affichage des valeurs mesurées

À la fin de la mesure, la valve intégrée s'ouvre automatiquement pour un dégonflement rapide du brassard.

Les valeurs mesurées (Systole, Diastole, Pouls) sont affichées (voir figure 7).



Figure 7

Systole
mmHg

Diastole
mmHg

Pouls/min.

Si après la mesure, le symbole « «(♥)» » s'affiche, une répétition de la mesure est recommandée. Pendant cette seconde mesure, veillez à garder le bras totalement immobile. L'affichage répété du symbole « «(♥)» » alors que le bras est parfaitement immobile peut être le signe d'une arythmie. Parlez-en à votre médecin lors de votre prochaine consultation.

FR

La tension artérielle est une grandeur dynamique qui peut varier en fonction du maintien du patient, notamment la position assise, debout ou allongée, un mouvement avant ou pendant la mesure, l'état physique général du patient (stress, maladie, etc.).

► Si le résultat est manifestement faux, répétez la mesure.

Affichage des valeurs mesurées

Au bout d'une minute environ, l'appareil s'éteint automatiquement. Pour répéter une mesure, appuyez de nouveau **brièvement** sur la touche Marche.



Attendez au minimum 2 minutes entre deux mesures.

- Si aucune autre mesure n'est nécessaire, retirez le brassard de votre bras.

FR

Installer l'application et établir la communication



Nécessite une interaction avec boso-App



Nécessite une interaction avec boso medicus system

Afin de permettre l'échange de données entre l'appareil de mesure de la tension et votre portable, vous devez procéder de la manière suivante :



– Assurez-vous que Bluetooth est activé sur votre portable. (Bluetooth 4.0 doit être disponible).

– Téléchargez l'application boso depuis Google/Apple Store.



À l'installation de l'application, pour des raisons inhérentes au système d'exploitation (Android/iOS), l'autorisation d'accès du site actuel sera demandée.

Répondre « OUI » pour éviter des erreurs lors de la connexion BT.


Remarque: L'information "emplacement actuel" n'est pas requise par l'application boso mais par le système d'exploitation pour la connexion Bluetooth.

Installer l'application et établir la communication



- Lancez l'application boso sur votre portable.
- Créez un nouveau compte utilisateur :
 1. Sélectionnez « Utilisateur » dans le menu principal.
 2. Sélectionnez « + Nouveau » dans la barre de menu du bas.
 3. Saisissez vos données personnelles. Les champs obligatoires sont signalés par un « * ».
 4. Cliquez sur le bouton « Enregistrer » dans la barre de menu du bas pour enregistrer les données saisies.
- Sélectionnez l'utilisateur pour lequel les valeurs mesurées doivent être enregistrées en cochant.

FR

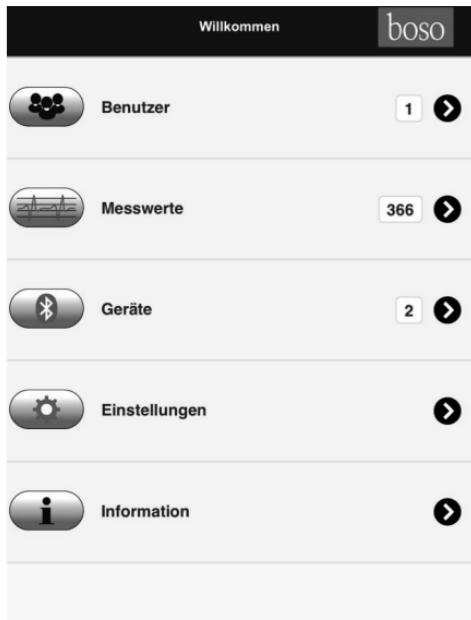

Installer l'application et établir la communication



- Cliquez sur le bouton « Précédent » dans la barre de menu du haut pour revenir au menu principal.
- Dans le menu principal, sélectionnez « Appareils ».
- Appuyez sur la touche START de l'appareil de mesure de la tension et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que « Pr » apparaisse à l'écran. Le voyant de communication reste affiché pendant environ une minute.
- Dans le menu « Appareils » dans la barre de menu du bas, sélectionnez « Ajouter un nouvel appareil ».



Si vous utilisez iOS, vous devez valider la requête de connexion en sélectionnant « Connexion ».

- La date et l'heure sont automatiquement synchronisées par le portable.
- Après que la connexion ait réussi, le mot « Fin » apparaîtra sur l'écran de l'appareil et l'appareil sera affiché dans la liste des appareils de l'application.

FR

L'installation est terminée. Sélectionnez « Précédent » dans la barre de menu du haut pour quitter le menu.

Installer l'application et établir la communication

Après avoir **remplacé la batterie**, vous devez connecter de nouveau le tensiomètre à l'appareil mobile car l'heure a été supprimée. Si vous ne le faites pas, l'heure système actuelle de l'appareil mobile sera enregistrée comme estampille temporelle pour les mesures au moment du transfert des données.

Procéder de la manière suivante :

- Supprimer le tensiomètre de la liste des appareils de l'application
- Supprimer le tensiomètre des paramètres Bluetooth de l'appareil mobile
- Connecter de nouveau le tensiomètre comme décrit.



Mesure de la tension et transfert des données

Posez le brassard et prenez la tension comme décrit dans le mode d'emploi.



Tant que Bluetooth est actif et que l'application est ouverte, les valeurs mesurées sont transférées automatiquement après la mesure.



Après avoir été correctement transférée, la valeur mesurée est supprimée de la mémoire de l'appareil de mesure de la tension.



Si les données n'ont pas été transférées, activez de nouveau la connexion. Lorsque l'application ou Bluetooth sont inactifs, jusqu'à 30 mesures sont enregistrées automa-

tiquement dans l'appareil de mesure de la tension (Si la mémoire est pleine (30 mesures), la mesure la plus ancienne est supprimée et la dernière mesure est enregistrée. Les erreurs de mesure ne sont pas enregistrées) et transférées à la fin de la mesure suivante après activation de l'application.

FR


Pour transmettre à l'application toutes les mesures enregistrées dans la mémoire du système medi-cus, l'application de toutes les mesures doit avoir été activée dans le menu « Paramètres » (réglage par défaut). Si la touche « Dernière » est sélectionnée, seule la dernière

Mesure de la tension et transfert des données

mesure sera transférée et toutes les mesures enregistrées seront supprimées.

Dans ce menu, les heures de l'évaluation du matin et de celle de l'après-midi peuvent être modifiées.

Sélectionnez le bouton « Enregistrer » dans la barre de menu du bas pour enregistrer vos paramètres.

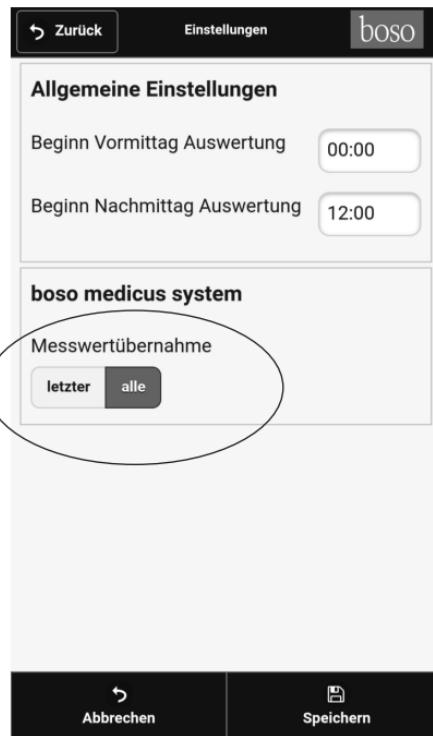

Évaluation et envoi des données




Toutes les mesures transférées jusqu'ici sont affichées dans le menu « Mesures ».

En sélectionnant le bouton « Graphiques » dans la barre de menu du bas, vous obtenez une présentation des mesures sous forme de graphique.

Pour sélectionner les graphiques disponibles, sélectionnez les boutons « SYS/ DIA » et « PULS » dans le haut de l'écran. Touchez le graphique pour l'agrandir ou le réduire.

« kg/IMC » est prévu pour une balance.

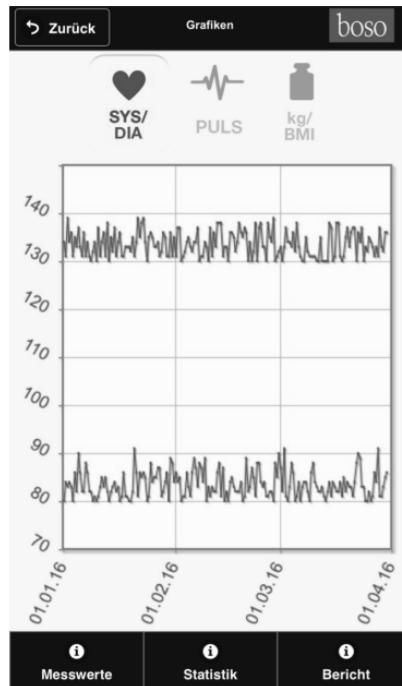

Évaluation et envoi des données



En sélectionnant le bouton « Statistiques » dans la barre de menu du bas, vous obtenez un récapitulatif des mesures. Vous pouvez sélectionner la période de ce récapitulatif (date de/à).

En sélectionnant le bouton « Compte rendu » dans la barre de menu du bas, vous accédez au menu d'envoi des mesures. Le récapitulatif peut être envoyé par e-mail au format PDF ou XML.

Les fichiers XML peuvent être lus dans le programme « boso profil-manager XD Home ».

Ce programme propose d'autres possibilités d'évaluation. Il est disponible gratuitement sur Internet (<http://www.boso.de/download/profilmanagerXDHome/>).

FR

Zurück Bericht boso

An:

Kopie:

Email
Text:

Als XML senden Als PDF senden

Suppression de mesures



Il est possible de supprimer des mesures sélectionnées ou datant de plus de 1/3/6/12 mois dans le menu « Mesures ». Sélectionnez pour cela le bouton « Supprimer » dans la barre de menu du bas.

Attention : les données seront définitivement supprimées. N'oubliez pas d'archiver vos données en temps voulu en créant un fichier XML ou PDF (barre de menu « Compte rendu »).

17.10.2018 11:09:00	SYS	DIA	PUL	Arr	kg	<input type="checkbox"/>
30.03.2016 18:00:00	136	86	66	-	-	<input type="checkbox"/>
30.03.2016 08:00:00	-	-	-	-	78,5	<input type="checkbox"/>
30.03.2016 08:00:00	136	85	68	-	-	<input type="checkbox"/>
29.03.2016 18:00:00	-	-	-	-	78,8	<input type="checkbox"/>
29.03.2016 18:00:00	132	83	67	-	-	<input type="checkbox"/>
29.03.2016 08:00:00	-	-	-	-	78,7	<input type="checkbox"/>
29.03.2016 08:00:00	133	81	65	-	-	<input type="checkbox"/>
28.03.2016	-	-	-	-	78,9	<input type="checkbox"/>

FR

Alimentation secteur

Sur l'arrière de l'appareil se trouve une douille de connexion pour le transformateur. Utilisez si nécessaire le transformateur boso (**référence 410-7150**). Ce transformateur est réglé sur la tension de l'appareil, stabilisé et correctement polarisé. Des transformateurs différents peuvent endommager l'électronique et entraîner la perte de la garantie usine. En outre, l'utilisation d'un autre bloc d'alimentation peut entraîner un risque d'incendie.

FR

⚠ Ne pas toucher les batteries, la prise du bloc d'alimentation et le patient en même temps.

⚠ Détacher la fiche du bloc d'alimentation du tensiomètre quand il n'est pas utilisé.

Messages d'erreur

Si un problème se présente pendant la mesure de la tension, l'écran affiche un message d'erreur à la place du résultat de la mesure.

Signification des messages d'erreur :

	Signification du message Err :	Solution :
	Variation excessive de la tension du brassard pendant la mesure	Maintenir le bras immobile
	Lecture impossible des pulsations	Contrôler la position du brassard (voir page 118) et répéter la mesure.
	Différence systole – diastole trop faible : systole – diastole ≤ 10 mmHg	Contrôler la position du brassard (voir page 118) et répéter la mesure.
	Erreur lors du gonflage	Contrôler que le brassard n'est pas trop lâche, le resserrer si nécessaire (voir page 118).

FR

Messages d'erreur

Signification du message Err :	Solution :
	La valeur de pulsation n'a pu être déterminée correctement Vérifier la position du brassard et répéter la mesure
 	Erreurs internes Retirez les piles et appuyez sur le bouton START brièvement. Remettre les piles dans le boîtier. Si l'erreur persiste, retournez l'appareil au fabricant pour réparation.
	Affichage du symbole « «心» » Solution : La répétition de la mesure est recommandée ; maintenir le bras parfaitement immobile. L'affichage répété du symbole « «心» » alors que le bras est parfaitement immobile peut être le signe d'une arythmie. Parlez-en à votre médecin lors de votre prochaine consultation.

FR

Messages d'erreur

Signification du message Err :	Solution :
	Erreur lors de la connexion Bluetooth Retirez les piles et appuyez sur le bouton START brièvement. Remettez les piles dans le boîtier. Recommencez le processus de connexion. Si l'erreur persiste, retournez l'appareil au fabricant pour réparation.
	À l'installation de l'application, pour des raisons inhérentes au système, l'autorisation d'accès du site actuel sera demandée. Répondre « OUI » pour éviter des erreurs lors de la connexion BT.

FR

Nettoyage et désinfection

Nettoyage l'appareil :

Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer l'appareil.

Nettoyage Brassard :

Pour enlever les petites taches sur le brassard, utilisez un liquide vaisselle classique.

Désinfection l'appareil :

Pour désinfecter l'appareil et le brassard à l'aide d'un chiffon (durée d'action 5 minutes minium), nous vous conseillons d'utiliser le désinfectant antifect liquid (Schülke & Mayr). Pour désinfecter le brassard, nous vous recommandons la désinfection par pulvérisation. Il est tout particulièrement recommandé de régulièrement nettoyer et désinfecter le brassard, surtout lorsque l'appareil est utilisé par plusieurs utilisateur.



Conditions de Garantie

Nous accordons une garantie d'usine de 3 ans à compter de la date d'achat. La date d'achat doit être attestée par la facture. Les articles défectueux seront éliminés gratuitement pendant la durée de la garantie. En cas d'utilisation de garantie, aucune prolongation de durée de garantie n'interviendra sur l'appareil entier mais uniquement pour les pièces remplacées.

De la garantie sont exclus les dommages dus à une usure normale (par ex. bracelets), au transport et les dommages causés par un maniement non approprié (par ex. l'inobservation des instructions d'utilisation) ou les dommages dus à des interférences par des personnes non autorisées .

Tout autre droit, à quelque titre juridique que ce soit ne peut être reconnu.

En cas de recours à la garantie d'usine, l'appareil doit être envoyé avec la facture originale à:

BOSCH + SOHN GMBH U. CO. KG,
Bahnhofstr. 64, D-72417 Jungingen.

boso n'est en aucun cas responsable en cas de perte telles que problèmes de système ou perte de données qui peuvent survenir au cours de l'utilisation de cet appareil de mesure de la tension.

Il n'est pas garanti que cet appareil de mesure de la tension puisse se connecter avec tous les appareils Bluetooth compatibles.



Service après-vente

Service après-vente

Les interventions sous garantie ou les réparations doivent être confiées à un professionnel autorisé et formé. Ne pas modifier cet équipement sans l'autorisation du fabricant. Envoyez l'appareil soigneusement emballé avec un affranchissement suffisant à votre distributeur autorisé ou directement à :

BOSCH + SOHN GmbH u. Co. KG
Serviceabteilung
Bahnhofstraße 64, D-72417 Jungingen
T: +49 (0) 74 77 / 92 75-0



Élimination



L'appareil et les piles ne sont pas des déchets ménagers.

En fin de vie, l'appareil doit être rapporté à un point de collecte pour équipements électroniques.

Les piles classiques et rechargeables sont des déchets spéciaux. (à ramener au point de collecte de votre localité).

Durée de vie prévue de l'appareil : 5 ans (En utilisant l'appareil 6 fois par jour)

Durée de vie prévue du brassard : 2 ans (En utilisant l'appareil 6 fois par jour)

Caractéristiques techniques

Principe de mesure : oscilloscopique

Plages de mesure :
systolique: 60 à 279 mmHg
diastolique: 40 à 200 mmHg
Pouls: 40 à 180 par minute

Pression du brassard : 0 à 299 mmHg

Capacité de la mémoire : 30 mesures

Affichage : LCD

Conditions d'utilisation : Température ambiante +10 °C à +40 °C
Humidité relative de l'air 15 à 85 %
Pression d'air de 800 hPa à 1060 hPa

Transport / Conditions de stockage : Température ambiante –20 °C à +60 °C

Humidité relative de l'air 10 à 95 %
Pression d'air de 700 hPa à 1060 hPa

Alimentation électrique : 6 V CC (piles 4 x 1,5 V Mignon CEI LR 6, manganèse-alcaline)
En option : Transformateur 6 V CC, référence 410-7-150



Caractéristiques techniques

FR

Durée de vie habituelle des piles :	500 cycles de mesure (sans tenir compte de l'intensité de pompage et de la fréquence d'utilisation)
Contrôle des piles :	Témoin de charge sur l'afficheur
Poids :	250 g (sans piles)
Dimensions (L x h x l) :	96 mm x 68 mm x 130 mm
Classification :	Dispositif médical avec source d'énergie interne (en mode batterie) / classe II (en mode secteur), mode continu
Partie appliquée:	Type BF (✉)
Protection contre les objets solides :	IP 20 <p>La classification IP est le degré de protection fourni par les enceintes conformément à la IEC 60529. Cet appareil est protégé contre des objets étrangers solides de 12 mm de diamètre et plus grands tels que les doigts. Cet appareil n'est pas protégé contre l'eau.</p>

Caractéristiques techniques

Test clinique :	La précision de mesure est conforme aux exigences de la norme ISO 81060 partie 2
Bluetooth :	version Bluetooth 4.0
Écart de pression maximal au niveau du brassard :	$\pm 3 \text{ mmHg}$ ou 2% de la valeur lue (la valeur la plus élevée est applicable)
Tolérance du dispositif de mesure du pouls :	$\pm 5 \%$
Normes appliquées :	DIN EN ISO 80601-2-30 „Medical electrical equipment - Part 2-30: Particular requirements for the basic safety and essential performance of automated type non-invasive sphygmomanometers”.
Communication sans fil :	VZ (MURATA Manufacturing Co. Ltd.) Bluetooth Ver.4.OLE BLP Bande de fréquence : 2402-2480 MHz Puissance de sortie RF maximale : 1.6dBm Modulation: GFSK



Instructions relatives au contrôle technique de l'appareil

(uniquement pour les techniciens formés)

Le contrôle technique – au plus tard tous les 2 ans – doit être réalisé par les organisations ou personnes suivantes :

- Fabricant
- Organismes responsables du contrôle de la mesure
- Personnes qui remplissent les conditions de la réglementation nationale en vigueur.



A) Essai de fonctionnement

Un essai de fonctionnement de l'appareil ne peut être effectué que sur une personne ou sur un simulateur approprié.

B) Contrôle de l'étanchéité du circuit de pression et de l'affichage de la tension

Remarque :

- a) Si la tension en mode de mesure est supérieure à 299 mmHg, la soupape de dégonflement rapide ouvre le circuit de pression. Lorsque la pression en mode de contrôle est supérieure à 320 mmHg, la valeur mesurée affichée clignote.
- b) Pour la vérification de l'étalonnage, une prise de test spéciale doit être utilisée. La prise de test est disponible chez le fabricant moyennant un supplément.

Instructions relatives au contrôle technique de l'appareil (uniquement pour les techniciens formés)

Une poire de gonflage doit en outre être ajoutée au circuit de pression.

(respectez la durée minimale d'application du brassard, soit 30 s) de manière habituelle.

Vérification

- 1.) Retirez les piles.
- 2.) Appuyez et maintenez la pression sur la touche Marche et insérez les piles.
- 3.) Relâchez la touche Marche. L'appareil se trouve en mode de contrôle ; la tension actuelle est affichée dans les champs SYS et DIA.
- 4.) Contrôlez l'exactitude de l'affichage et l'étanchéité du circuit de pression

- 5.) Éteignez de nouveau l'appareil en appuyant sur la touche Marche.

 Il est interdit d'effectuer des travaux d'entretien et des réparations sur l'appareil pendant qu'il est utilisé.



Indice

Descrizione dell'apparecchio	148
Dotazione di fornitura	149
Simboli sullo sfigmomanometro e nell'app	150
Simboli sull'alimentatore	153
Guida rapida	154
Introduzione	155
Destinazione d'uso	156
Valori pressori	157
Valori di pressione sistolica e diastolica	157
Valori limite OMS per la valutazione dei valori pressori	157
Messa in funzione dell'apparecchio	159
Inserimento delle batterie	159
Indicatore di carica delle batterie	160
Avvertenze generali per l'automisurazione della pressione arteriosa	161
Avvertenze generali sulla connessione Bluetooth	163
Preparazione alla misurazione della pressione arteriosa	165
Avvertenza sulla misura del bracciale	165

IT

Indice

Come indossare il bracciale	166
Misurazione della pressione arteriosa	169
Interruzione della misurazione	170
Visualizzazione dei valori pressori	171
Configurazione dell'app e creazione del collegamento	173
Misurazione e trasmissione della pressione arteriosa	177
Valutazione e invio delle misurazioni	179
Cancellazione dei valori	181
Utilizzo con la rete elettrica	182
Codici di errore	183
Pulizia e disinfezione	186
Condizioni di Garanzia	187
Servizio clienti / Smaltimento	188
Specifiche tecniche	189
Istruzioni per il controllo metrologico (solo per il personale specializzato addestrato)	192

IT

Descrizione dell'apparecchio



IT

Dotazione di fornitura

1 sfigmomanometro
boso medicus system



4 batterie tipo LR 6 (AA)



1 bracciale universale
CA 04



1 manuale di
istruzioni



1 custodia



IT

Simboli sullo sfigmomanometro

Simbolo	Funzione/Significato
	Tasto START/STOP
	Corrente continua
	Numero di serie
	Anno di fabbricazione
	Tipo BF: apparecchio, bracciale e tubazioni sono stati sviluppati in modo che il paziente sia protetto dalla folgorazione.
	Comunicazione Bluetooth attiva.
	Misurazione in corso. Lampeggia non appena individuato un battito cardiaco.

Simboli sullo sfigmomanometro


Simbolo	Funzione/Significato
	Irregolarità del ritmo cardiaco o movimento durante la misurazione.
	Batteria completamente carica.
	Batteria parzialmente scarica.
	Sostituire la batteria al più presto.
	Lampeggia! Impossibile continuare la misurazione. Sostituire le batterie.
	Proteggere dai liquidi

IT

Simboli sullo sfigmomanometro e nell'app

Simbolo	Funzione/Significato
SYS	Pressione sistolica in mmHg
DIA	Pressione diastolica in mmHg
PUL	Pulsazioni al minuto
Arr	Misurazione con irregolarità del ritmo cardiaco o movimento
CE 0124	L'apparecchio è conforme alla direttiva europea sui dispositivi medici.
	L'apparecchio non deve essere smaltito con i rifiuti urbani generici.
	Produttore
	Leggere le istruzioni per l'uso
	Polarità della presa dell'alimentatore

Simboli sull'alimentatore

Simbolo	Funzione/Significato
	Da usare solo in ambienti chiusi.
	Apparecchio della classe di protezione II
	Fusibile termico
	Fusibile
	L'apparecchio è conforme alla Direttiva europea sui dispositivi medici
	Polarità della presa dell'adattatore a rete

IT

Guida rapida

- ▶ Inserire le batterie, facendo attenzione alla polarità corretta (pag. 159)
- ▶ Collegare il bracciale allo sfigmomanometro (pag. 165)
- ▶ Applicare il bracciale sul braccio (pag. 166)
- ▶ Per avviare (e terminare) la misurazione, premere il pulsante Start (pag. 169)

L'apparecchio visualizza i valori di pressione sistolica, pressione diastolica e polso al termine della misurazione (pag. 171)



La presente guida rapida non sostituisce le informazioni dettagliate contenute nel Manuale di istruzioni per l'uso sicuro dello sfigmomanometro.



Legga quindi in ogni caso il manuale di istruzioni!

Introduzione

Gentile cliente,
la ringraziamo cordialmente per aver
acquistato uno sfigmomanometro boso.
Boso è simbolo di alta qualità e precisione ed è la marca di prima scelta anche tra i professionisti: Il 96% di tutti i medici generali, medici di base e internisti tedeschi usano nei loro ambulatori gli sfigmomanometri boso. (Studio API dell'istituto di ricerche GfK 01/2016). Dall'esperienza decennale maturata nel settore professionista traggono vantaggio anche gli apparecchi destinati ai pazienti per l'automisurazione a domicilio.

Questo apparecchio ha superato i nostri rigidi controlli di qualità ed è un partner affidabile per il controllo dei valori pressori.

⚠️ Legga con attenzione il presente manuale di istruzioni prima del primo

impiego, perché l'uso corretto dell'apparecchio è indispensabile per una misurazione corretta della pressione arteriosa. In questo manuale di istruzioni il simbolo "➡" indica un'azione effettuata dall'utente.

Per assistenza nella messa in funzione, nell'utilizzo e nella manutenzione dell'apparecchio, rivolgersi al proprio rivenditore o al produttore (i dati di contatto sono sul retro della copertina delle presenti istruzioni per l'uso).

Eventuali anomalie nel funzionamento o un evento che ha peggiorato o avrebbe potuto peggiorare lo stato di salute devono essere segnalati tempestivamente al produttore.

IT

Introduzione

In caso di cessione, all'apparecchio deve essere allegato il presente manuale di istruzioni.

Lo sfigmomanometro boso-medicus system è indicato per pazienti che abbiano una circonferenza del braccio compresa tra 22 e 48 cm.

L'utilizzo di accessori non menzionati nelle presenti istruzioni per l'uso può compromettere la sicurezza.

Dispositivi di comunicazione wireless, come dispositivi elettrici wireless domestici, telefoni cellulari, telefoni cordless e le loro stazioni radio base, walkie-talkie, possono influenzare questo monitor della pressione arteriosa. Pertanto, deve essere mantenuta una distanza minima di 30 cm da tali dispositivi.

La trasmissione radio Bluetooth dell'apparecchio soddisfa la direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53/EU.

Destinazione d'uso

Rilevamento non invasivo del valore della pressione sistolica e diastolica e della frequenza delle pulsazioni negli adulti. Non idoneo all'impiego per neonati e nella prima infanzia. L'apparecchio è idoneo per l'automisurazione domiciliare. Il paziente è considerato l'operatore.

L'apparecchio può essere impiegato su un braccio di qualsiasi circonferenza come indicato sul bracciale.

Valori pressori

Per determinare la pressione arteriosa si devono misurare **due valori**:

● Pressione sistolica (massima)

Dovuta alla contrazione del cuore che pompa il sangue nei vasi sanguigni.

● Pressione diastolica (minima)

Si presenta quando il cuore è disteso e si riempie nuovamente di sangue.

I valori di pressione arteriosa vengono espressi in mmHg (mm di mercurio).

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha elaborato i seguenti valori limite per la valutazione della pressione arteriosa:

	Sistolica	Diastolica
Pressione arteriosa elevata (ipertensione)	da 140 mmHg	da 90 mmHg
Pressione arteriosa ancora nell'ambito della norma	da 130 a 139 mmHg	da 85 a 89 mmHg
Pressione arteriosa normale	da 120 a 129 mmHg	da 80 a 84 mmHg
Pressione arteriosa ottimale	fino a 119 mmHg	fino a 79 mmHg

Valori pressori

La necessità di una terapia farmacologica viene stabilita non solo in base ai valori pressori, ma anche in base al profilo di rischio di ogni paziente. Consulti il medico se uno solo dei due valori (pressione sistolica, pressione diastolica) supera costantemente i valori limite che indicano una pressione arteriosa elevata.

I valori pressori determinati a domicilio sono spesso leggermente inferiori ai valori determinati dal medico. Per questo, la Lega tedesca contro l'ipertensione (Deutsche Hochdruckliga) ha stabilito valori limite inferiori per l'automisurazione a domicilio:

misurazione a domicilio: 135/85 mmHg
misurazione nello studio medico: 140/90 mmHg

Messa in funzione dell'apparecchio

L'apparecchio deve essere installato e messo in funzione in base alle informazioni contenute in questo manuale.

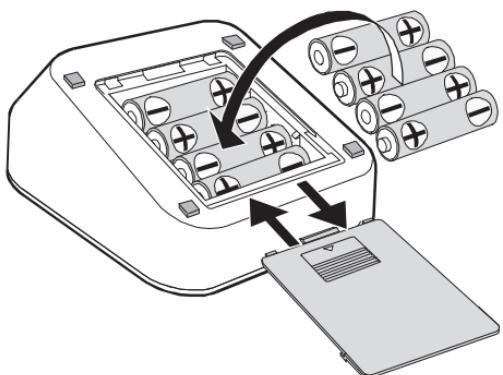


Fig. 1

- Utilizzare esclusivamente batterie di qualità anti-perdita del tipo indicato (vedere "Specifiche tecniche" a pag. 189).

⚠ Non utilizzare mai contemporaneamente batterie vecchie e nuove o batterie di marche diverse.

⚠ In caso di polarità errata l'apparecchio non funziona ed esiste il rischio di sviluppo di calore, perdite dalle batterie e danni permanenti all'apparecchio.

→ Inserimento delle batterie

Il vano batterie è situato sulla parte inferiore dell'apparecchio. Inserire le batterie nel vano apposito, come indicato nella Fig. 1.

- Rimuovere le batterie nel caso l'apparecchio non venga utilizzato per periodi prolungati.

⚠ In caso di cortocircuito delle batterie, queste possono surriscaldarsi e causare ustioni.

IT

Messa in funzione dell'apparecchio

L'apparecchio visualizza la carica delle batterie (vedere pag. 151)

-  Batterie completamente cariche.
-  Batterie parzialmente cariche.
-  Batterie da sostituire entro breve.
-  Lampeggiante! Non è possibile effettuare misurazioni.
Sostituire le batterie.



Come contribuire alla protezione dell'ambiente

Le batterie utilizzate e le batterie ricaricabili non devono essere gettate nei rifiuti domestici e possono essere consegnate ai centri di raccolta per batterie usate e rifiuti speciali.

Per ulteriori informazioni si prega di rivolgersi al proprio comune di residenza.

Avvertenze generali per l'automisurazione della pressione arteriosa

1. Le oscillazioni dei valori pressori sono normali. Anche in caso di misurazione ripetuta possono verificarsi oscillazioni notevoli. Le misurazioni isolate o effettuate a intervalli irregolari non forniscono dati affidabili sui valori pressori reali.
Una valutazione affidabile è possibile solo effettuando misurazioni a intervalli regolari e nelle stesse condizioni e riportando i valori nell'apposito diario della pressione arteriosa.
2.  L'automisurazione della pressione arteriosa non costituisce una terapia. Non modifichi per **nessuna** ragione la posologia dei medicinali prescritta dal medico.
3. Le alterazioni del ritmo cardiaco possono compromettere la precisione dell'apparecchio e dare luogo a misurazioni errate (vedere pag. 184).
4. Nei pazienti con polso debole (ad es. nei portatori di pace-maker) possono verificarsi misurazioni errate. Lo sfigmomanometro non influisce in alcun modo sui pace-maker.
5. L'apparecchio non è convalidato per le donne in gravidanza.
6. La misurazione deve sempre essere effettuata in condizioni di riposo. Si consiglia di misurare la pressione arteriosa due volte al giorno: al mattino al risveglio e alla sera, dopo essersi rilassati dopo la giornata di lavoro.

IT

Avvertenze generali per l'automisurazione della pressione arteriosa

7. Salvo controindicazioni (vedere pag. 167), la pressione arteriosa deve sempre essere misurata sul braccio che presenta i valori pressori più elevati.
Occorre quindi determinare una volta la pressione su entrambe le braccia e, in seguito, sempre sul braccio che presenta i valori pressori più elevati.

IT

Avvertenze generali sulla connessione Bluetooth

- **⚠️** Lo sfigmomanometro non deve essere impiegato in luoghi nei quali la comunicazione senza fili è vietata, ad esempio nei velivoli o negli ospedali. Questo sfigmomanometro può avere degli effetti dannosi sugli apparecchi elettronici o sugli apparecchi elettronici medici.
- La distanza di comunicazione massima tra sfigmomanometro e ricevitore è pari a circa 10 metri. Questa distanza può ridursi a seconda dell'ambiente circostante; verificare pertanto che la distanza sia sufficientemente breve per consentire la trasmissione dei dati dopo la misurazione.
- Accertare che lo spazio tra lo sfigmomanometro e il dispositivo mobile non sia edificato. La distanza di comunicazione può essere ridotta dalla struttura edile dell'edificio o da altri ostacoli. In determinate circostanze la comunicazione potrebbe risultare impossibile, in particolare in presenza di muri di calcestruzzo armato, ecc.
- La funzione Bluetooth, durante l'accoppiamento, deve essere disattivata in tutti gli altri apparecchi presenti entro la portata.
- Nel caso improbabile in cui lo sfigmomanometro disturbi degli altri dispositi-

IT

Avvertenze generali sulla connessione Bluetooth

tivi di comunicazione senza fili, impiegare lo sfigmomanometro in un altro luogo.

- Non impiegare la connessione Bluetooth nei pressi di un apparecchio WLAN IEEE802.11g/b/n o di altri impianti di comunicazione senza fili (soprattutto nella gamma dei 2,4 GHz) ovvero nei pressi di apparecchi che emettono onde elettromagnetiche (ad esempio gli apparecchi a microonde). Questo potrebbe causare l'interruzione frequente della connessione, la riduzione notevole della velocità di comunicazione e l'insorgenza di errori.


Preparazione alla misurazione della pressione arteriosa

! L'apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente con i seguenti bracciali scelti in base alla circonferenza del proprio braccio, che è riportata anche sul bracciale stesso.

Tipo	Circonferenza del braccio	Numero d'ordine
CA01	22 – 32 cm	143-4-764
CA02	32 – 48 cm	143-4-757
CA04	22 – 42 cm	143-4-765*

* Bracciale universale compreso nella fornitura standard.

Collegare il bracciale all'apparecchio inserendo la spina (fino allo scatto) nella presa situata sul lato sinistro dell'apparecchio. (vedere Fig. 2).

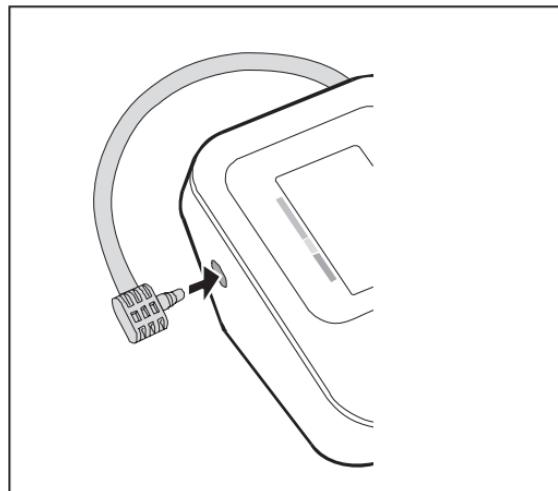

IT

Fig. 2

Avvertenza sulla misura del bracciale

Aspetti da ricordare durante la misurazione della pressione arteriosa



Evitare il consumo di nicotina e caffè un'ora prima della misurazione.



Sedersi in posizione comoda, con schiena e braccia appoggiate. Non accavallare le gambe. Appoggiare la pianta dei piedi sul pavimento. Rilassarsi per 5 minuti prima di misurare la pressione.
Evitare di muoversi durante la misurazione.

IT

Come indossare il bracciale

Effettuare la misurazione sul braccio nudo.

⚠ Se si indossano abiti aderenti, fare attenzione a ribaltare le maniche senza stringere il braccio (se necessario, togliere l'indumento prima della misurazione).

→ Spingere il bracciale aperto ad anello sul braccio, fino a che il margine inferiore del bracciale venga a trovarsi circa 2-3 cm sopra la piega del gomito. Il bracciale deve essere posizionato in modo tale che la linea di marcatura venga a trovarsi sopra l'arteria (vedere Fig. 3).

Avvertenza sulla misura del bracciale

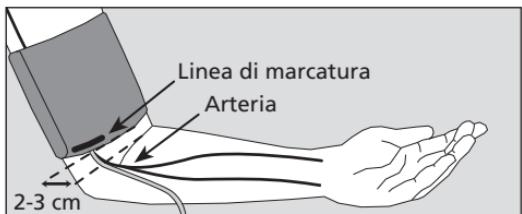


Fig. 3

⚠ Per evitare ulteriori lesioni, il bracciale non deve essere posizionato in corrispondenza di ferite.

⚠ Non posizionare il bracciale su un braccio nel quale le arterie o le vene sono o sono state oggetto di trattamento (ad es. fistola).

⚠ Per le donne che hanno subito l'amputazione di un seno: non applicare il bracciale sul lato dell'amputazione.

⚠ Durante la misurazione possono verificarsi disfunzioni degli apparecchi medici utilizzati contemporaneamente sullo stesso braccio.

⚠ Il bracciale non deve essere stretto in modo eccessivo: tra il braccio e il bracciale devono ancora poter passare circa due dita.

⚠ Non posizionare mai l'anello metallico sopra l'arteria (vedere Fig. 3); in caso contrario, i valori pressori possono risultare falsati.

→ Inserire la parte terminale del bracciale nell'anello metallico e farla passare verso l'esterno, avvolgendo il braccio. Chiudere bene la chiusura a velcro premendo leggermente.

IT

Avvertenza sulla misura del bracciale

- Dopo aver applicato il bracciale, appoggiare il braccio sul tavolo, tenendolo rilassato e leggermente piegato, in modo che il bracciale si trovi all'altezza del cuore.

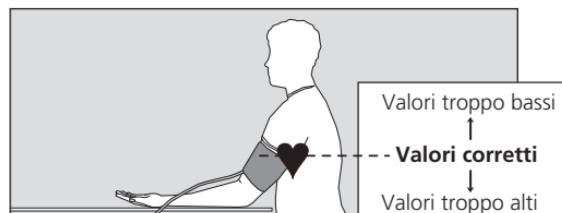


Fig. 4

IT



Non parlare durante la misurazione.

- ⚠ Fare attenzione a non piegare il tubo dell'aria durante la misurazione. Il ristagno di sangue che ne deriva può causare lesioni.

⚠ La misurazione non deve interrompere il flusso sanguigno per tempi eccessivamente lunghi (oltre 2 minuti). In caso di funzionamento difettoso dell'apparecchio, togliere il bracciale dal braccio.

⚠ Le misurazioni troppo frequenti possono ostacolare il flusso sanguigno e quindi provocare lesioni.

⚠ L'apparecchio non deve essere utilizzato da bambini non supervisionati.

⚠ Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di lattanti. Questo potrebbe causare incidenti o danni.

⚠ Non avviare l'apparecchio prima di aver applicato il bracciale.

⚠ Ci sono piccole parti che possono causare un rischio di soffocamento se ingerito per errore da parte dei neonati.

⚠ In caso di variazioni notevoli della temperatura ambiente, dare all'apparecchio circa un'ora di tempo per adattarsi alla nuova temperatura prima di utilizzarlo.

⚠ Le prestazioni dell'apparecchio possono essere influenzate da livelli troppo alti di temperatura, umidità o altitudine.

Misurazione della pressione arteriosa

→ Avviare la misurazione premendo il pulsante Start



⚠ Tenere il braccio immobile e non parlare.

Per il controllo funzionale dell'apparecchio verranno visualizzati brevemente tutti gli elementi dello schermo LCD (vedere Fig. 5).

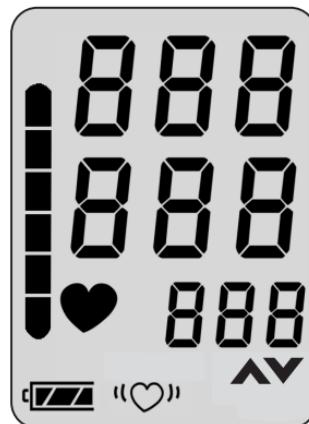


Fig. 5

IT

Misurazione della pressione arteriosa

La pompa inizia a gonfiare il bracciale.

L'apparecchio è dotato di un automatismo di gonfiaggio "intelligente", che assicura un gonfiaggio atraumatico fino alla corretta pressione di gonfiaggio. La pressione crescente del manico viene visualizzata sotto forma di valore numerico digitale e di barre sul bordo sinistro dello schermo.

Quando la **corretta pressione di gonfiaggio** è stata raggiunta, la pompa si ferma e l'aria fuoriesce lentamente dal bracciale.

IT

⚠ Interruzione della misurazione

La misurazione può essere interrotta in qualsiasi momento premendo il pulsante Start, che permette di sgonfiare automaticamente il bracciale.

Durante la fase di misurazione vengono visualizzati la pressione di gonfiaggio decrescente e il simbolo  lampeggiante (vedere Fig. 6).



Fig. 6

Visualizzazione dei valori pressori

Al termine della misurazione, la valvola integrata si apre automaticamente e il bracciale si sgonfia rapidamente.

L'apparecchio visualizza i valori pressori misurati (pressione sistolica, pressione diastolica, polso) (vedere Fig. 7).



Fig. 7

P. sistolica
mmHg

P. diastolica
mmHg

Polso/min.

Se dopo la misurazione viene visualizzato il simbolo "♥", si consiglia di ripetere l'operazione tenendo il braccio immobile. La visualizzazione ripetuta del simbolo "♥", nonostante la misurazione sia stata effettuata con il braccio fermo, può essere un segno di alterazioni del ritmo cardiaco. Consulti il medico in occasione della prossima visita.

La pressione arteriosa è una grandezza dinamica che può variare a seconda della posizione del paziente (posizione seduta, eretta o coricata), di movimenti effettuati prima o durante la misurazione e delle condizioni di salute generali (stress, malattia ecc.).

→ In caso di valori pressori chiaramente errati, ripetere la misurazione.

IT

Visualizzazione dei valori pressori

Dopo circa 1 minuto l'apparecchio si spegne automaticamente. Per ripetere la misurazione premere di nuovo **brevemente** il pulsante Start.



Rispettare un intervallo di almeno due minuti tra due misurazioni successive.

- Se non si effettuano ulteriori misurazioni, rimuovere il bracciale dal braccio.

IT

Configurazione dell'app e creazione del collegamento



Richiede l'interazione con boso-App



Richiede l'interazione con boso medicus system

Al fine di consentire lo scambio dei dati tra lo sfigmomanometro e il proprio dispositivo mobile è necessario osservare i passi seguenti:



- Accertare che la funzione Bluetooth sia attiva sul proprio dispositivo mobile. (Il requisito preliminare è la disponibilità del Bluetooth 4.0)

– Scaricare l'app boso da Google/Apple Store.



Al momento dell'installazione della app il sistema operativo (Android/iOS) chiede obbligatoriamente il permesso all'accesso dell'ubicazione attuale.

Rispondere "Sì" a questa domanda per evitare errori nel collegamento BT.

Nota: l'informazione "posizione attuale" non è richiesta dall'app boso ma dal sistema operativo per la connessione Bluetooth.

IT

Configurazione dell'app e creazione del collegamento



- Avviare l'app boso sul proprio dispositivo mobile.
- Creare un nuovo utente:
 1. Selezionare "Utente" nel menù principale.
 2. Selezionare "+ Nuovo" nella barra del menù inferiore.
 3. Immettere i propri dati personali. I campi obbligatori sono contrassegnati con "*".
 4. Salvare i dati mediante il pulsante "Salvare" nella barra del menù inferiore.
- Contrassegnare con un segno di spunta l'utente per cui si desiderano salvare i valori.

IT



Configurazione dell'app e creazione del collegamento



- Mediante il pulsante "Indietro" nella barra del menù superiore tornare al menù principale.
- Nel menù principale aprire "Apparecchi".



- Premere il tasto START sullo stetoskopomaniometro fino a che sullo schermo compare "Pr". La visualizzazione di comunicazione sarà visualizzata sullo schermo per circa un minuto.



- Scegliere "Aggiungi nuovo apparecchio" nel menù "Apparecchi" nella barra del menù inferiore.



Con iOS la richiesta di accoppiamento deve anche essere confermata con "Accoppiare".

- Data e ora vengono sincronizzate automaticamente con quelle del dispositivo mobile.
- Dopo l'avvenuto accoppiamento, sullo schermo dell'apparecchio compare <End>; l'apparecchio viene visualizzato nell'elenco di apparecchi dell'app.

La configurazione è così conclusa. Uscire dal menù tramite il pulsante "Indietro" nella barra del menù superiore.

IT

Configurazione dell'app e creazione del collegamento

Dopo la sostituzione della batteria, lo sfigmomanometro deve essere nuovamente accoppiato con il dispositivo mobile perché la sostituzione della batteria cancella le informazioni temporali.
Se non si ripete l'accoppiamento, nella trasmissione dati viene salvata per i valori misurati l'ora attuale del sistema del dispositivo mobile.

Procedere come segue:

- Cancellare lo sfigmomanometro dalla lista dei dispositivi della app
- Cancellare lo sfigmomanometro dalle impostazioni Bluetooth del dispositivo mobile
- Eseguire di nuovo l'accoppiamento come descritto.

IT

Misurazione e trasmissione della pressione arteriosa

Appicare il bracciale ed eseguire la misurazione della propria pressione arteriosa come descritto in queste istruzioni per l'uso.



I valori misurati saranno trasmessi automaticamente al termine della misurazione fino a che la funzione Bluetooth è attiva e l'app è avviata.



A trasmissione avvenuta, il valore viene cancellata dalla memoria dei valori misurati dello sfigmomanometro.



Se i dati della misurazione non fossero stati trasmessi, eseguire nuovamente l'accoppiamento. Se l'app o il Bluetooth sono inattivi, lo sfig-

momanometro memorizza automaticamente fino a 30 valori (Se la memoria dei valori misurati è piena (30 misurazioni), la misurazione più obsoleta viene cancellata e viene salvata la misurazione attuale; le misurazioni errate non vengono salvate) che saranno trasmessi con la misurazione successiva dopo l'attivazione dell'app.

Per poter trasmettere all'app tutti i valori salvati nella memoria del sistema medicus, nel menù "Impostazioni" deve essere attivata l'acquisizione di tutti i valori (impostazione standard). Qualora qui venga scelto "Ultimo", sarà trasmesso e cancellato sempre e


IT

Misurazione e trasmissione della pressione arteriosa

solo l'ultimo valore misurato e tutti i valori misurati salvati in precedenza saranno cancellati.

In questo menù si possono anche modificare gli orari per la valutazione antimeridiana e pomeridiana.

Salvare le proprie impostazioni mediante il pulsante "Salvare" nella barra del menù inferiore.

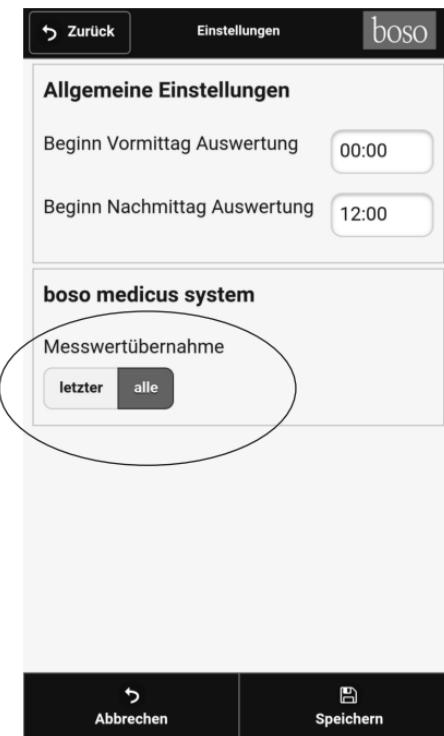

Valutazione e invio delle misurazioni




Nel menù "Valori misurati" sono visualizzati tutti i valori trasmessi fino a quel momento.

Tramite il pulsante "Grafici" nella barra del menù inferiore si visualizza la rappresentazione grafica dei valori misurati.

Con i pulsanti nella parte alta dello schermo "SYS/DIA", "PULS", è possibile visualizzare i grafici disponibili. Cliccare sul grafico per ingrandirlo o rimpicciolirlo.

Il pulsante "kg/BMI" è previsto per una bilancia.

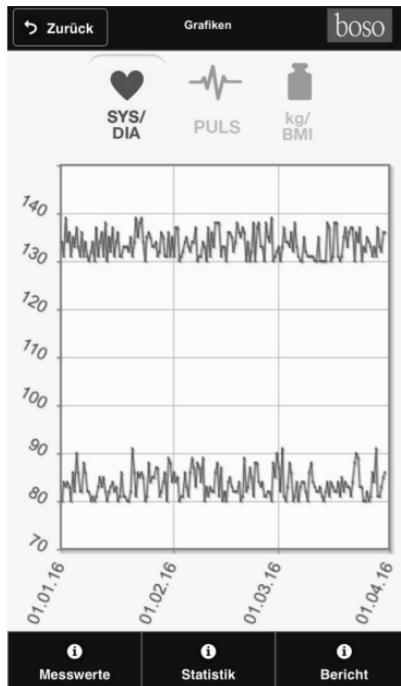

Valutazione e invio delle misurazioni



Tramite il pulsante "Statistiche" nella barra del menù inferiore è possibile creare un riepilogo statistico dei valori misurati. Sempre qui possono essere selezionati i limiti del riepilogo (data da/a).

Tramite il pulsante "Relazione" nella barra del menù inferiore si raggiunge il menù per inviare i valori il cui riepilogo può essere trasmesso via e-mail in formato PDF o XML. Il file XML può essere letto nel programma per PC "boso profilmanager XD Home". Questo programma offre ulteriori possibilità di valutazione ed è disponibile in internet (<http://www.boso.de/download/profilmanagerXDHome/>) a titolo gratuito.



Zurück | Bericht | boso

An:

Kopie:

Email
Text:

Als XML senden | Als PDF senden

Cancellazione dei valori



Tramite il pulsante "Cancellare" nella barra del menù inferiore è possibile eliminare singoli valori o valori che si trovano nel menù "Valori misurati" da più di 1/3/6/12 mesi.

Attenzione, i dati vengono cancellati in modo irreversibile. Vi ricordiamo di effettuare regolarmente il backup dei dati creando un file XML o PDF attraverso il pulsante "Rapporto".

		Zurück	Messwerte Max Mustermann				boso
			SYS	DIA	PUL	Arr	kg
17.10.2018 11:09:00	-	-	-	-	-	-	85
30.03.2016 18:00:00	136	86	66	-	-	-	
30.03.2016 08:00:00	-	-	-	-	-	-	78,5
30.03.2016 08:00:00	136	85	68	-	-	-	
29.03.2016 18:00:00	-	-	-	-	-	-	78,8
29.03.2016 18:00:00	132	83	67	-	-	-	
29.03.2016 08:00:00	-	-	-	-	-	-	78,7
29.03.2016 08:00:00	133	81	65	-	-	-	
28.03.2016	-	-	-	-	-	-	78,9

Utilizzo con la rete elettrica

Sulla parte posteriore dell'apparecchio si trova la presa per l'alimentatore di rete. Nel caso, utilizzare esclusivamente l'alimentatore boso (**N. d'ordine 410-7-150**). Questo alimentatore fornisce la tensione corretta, è stabilizzato ed è dotato della giusta polarità. Gli alimentatori di altre marche possono danneggiare le componenti elettroniche dell'apparecchio, con conseguente perdita della garanzia. Inoltre, gli alimentatori di altre marche possono comportare un rischio di incendio.

 Non toccare contemporaneamente le batterie, la presa di allacciamento dell'alimentatore e il paziente.

 Estrarre la spina dell'alimentatore dallo sfigmomanometro quando non viene usato.

Codici di errore

Qualora si verifichino problemi durante la misurazione, l'apparecchio visualizza un codice di errore anziché i valori pressori.

Significato dei codici di errore

Causa del codice di errore Err:	Risoluzione del problema
 Err	La pressione all'interno del bracciale oscilla eccessivamente durante la misurazione Tenere il braccio fermo
Assenza di pulsazioni analizzabili	Verificare la posizione del bracciale (vedere pag. 166) e ripetere la misurazione
Differenza p.sistolica – p. diastolica insufficiente: p. sistolica – p. diastolica $\leq 10 \text{ mmHg}$	Verificare la posizione del bracciale (vedere pag. 166) e ripetere la misurazione
 Err Euf	Errore di gonfiaggio Il bracciale potrebbe essere troppo largo; stringere il bracciale (vedere pag. 166)

IT

Codici di errore

Causa del codice di errore Err	Risoluzione del problema
	Il valore della pulsazione non può essere correttamente determinato Controllare la posizione del bracciale e ripetere la misurazione.
	Errore interno Togliere le batterie e premere brevemente il pulsante START. Rimettere le batterie nello strumento. Se l'errore persiste, rendere lo strumento al produttore per la riparazione
	Visualizzazione del simbolo "(♡)" Risoluzione del problema Si consiglia di ripetere la misurazione tenendo il braccio immobile. La visualizzazione ripetuta del simbolo "(♡)", nonostante la misurazione sia stata effettuata con il braccio fermo, può essere un segno di alterazioni del ritmo cardiaco. Consulti il medico in occasione della prossima visita.

IT

Codici di errore

Causa del codice di errore Err	Risoluzione del problema
 Err ID	Errore nella connessione Bluetooth Togliere le batterie e premere brevemente il pulsante START. Rimettere le batterie nello strumento. Eseguire nuovamente l'accoppiamento. Se l'errore persiste, rendere lo strumento al produttore per la riparazione
 Err II	Al momento dell'installazione della app il sistema chiede obbligatoriamente il permesso all'accesso dell'ubicazione attuale. Rispondere "Sì" a questa domanda per evitare errori nel collegamento BT.

IT

Pulizia e disinfezione

Pulizia Apparecchio

Pulire l'apparecchio con un panno asciutto morbido.

Pulizia Bracciale

Piccole macchie sul bracciale possono essere rimosse con attenzione con un normale detersivo per stoviglie.

Disinfezione

Per la disinfezione (tempo di azione di circa 5 minuti) dell'apparecchio e dell'anello di tenuta si raccomanda di utilizzare il disinfettante antifect liquid (Schülke & Mayr). Per disinfettare il bracciale, si consiglia la disinfezione a spruzzo. Assicurarsi che l'anello di tenuta sia regolarmente pulito e disinfettato, specialmente se l'apparecchio viene utilizzato da più utenti.

IT

Condizioni di Garanzia

I nostri prodotti sono garantiti per 3 anni dalla data di acquisto. Preghiamo sempre allegare allo strumento la fattura con la data di acquisto, rilasciata dal punto vendita. La garanzia si applica per difetti di fabbricazione del prodotto. Dopo la riparazione, il periodo di garanzia rimane sempre di 2 anni dalla data di acquisto. L'eventuale estensione di garanzia si applica esclusivamente alle parti sostituite.

Sono esclusi dalle clausole di garanzia le parti soggette a normale usura (es. bracciale), i danni derivanti dal trasporto ed eventuali danni causati da uso improprio (ad esempio, il mancato rispetto delle istruzioni per l'uso). Danni dovuti a manomissione da parte di persone non autorizzate sono pertanto esclusi dalla garanzia. In questi casi non saranno riconosciute even-

tuali richieste di risarcimento danni nei nostri confronti.

Per la manutenzione durante il periodo di garanzia, il dispositivo deve essere inviato insieme alla fattura a:
BOSCH + SOHN GMBH U. CO. KG,
Bahnhofstr. 64, D-72417 Jungingen.

boso non si assume alcuna responsabilità per le eventuali perdite che possono verificarsi in seguito all'uso di questo sfigmomometro, come ad esempio i disturbi d'esercizio o le perdite di dati.

Non si garantisce che questo sfigmomometro sia in grado di generare una connessione con tutti gli apparecchi compatibili con Bluetooth.

IT

Servizio clienti

Servizio clienti

Le prestazioni coperte da garanzia e le riparazioni devono essere effettuate dal personale appositamente addestrato e autorizzato. Non modificare questa apparecchiatura senza l'autorizzazione del costruttore. Inviare l'apparecchio, accuratamente imballato e correttamente affrancato, al proprio rivenditore autorizzato o direttamente a:

BOSCH + SOHN GmbH u. Co. KG
Serviceabteilung
Bahnhofstraße 64, D-72417 Jungingen
T: +49 (0) 74 77 / 92 75-0

IT

Smaltimento



L'apparecchio e le batterie non devono essere smaltiti nei rifiuti domestici.

Al termine della sua durata d'impiego, l'apparecchio deve essere smaltito presso un centro di raccolta del materiale elettronico usato.

Ricordare che le batterie e le batterie ricaricabili devono essere smaltite a parte (centro di raccolta del proprio comune).

Durata dell'apparecchio stimata: 5 anni (Utilizzando lo strumento 6 volte al giorno)

Durata dell'anello di tenuta: 2 anni (Utilizzando lo strumento 6 volte al giorno)

Specifiche tecniche

Metodo di misurazione:	oscillometrico
Ambito di misurazione:	sistolica: 60 – 279 mmHg diastolica: 40 – 200 mmHg Polso: 40 – 180 al minuto
Pressione del bracciale:	0 – 299 mmHg
Capacità di memoria:	30 misurazioni
Schermo:	a cristalli liquidi (LCD)
Condizioni operative:	temperatura ambientale: +10°C – +40°C umidità relativa: 15 – 85% Pressione aria da 800 hPa a 1060 hPa
Trasporto / Condizioni di immagazzinamento:	temperatura ambientale: –20°C – +60°C umidità relativa: 10 – 95% Pressione aria da 700 hPa a 1060 hPa
Alimentazione:	DC 6 V (4 batterie mignon 1,5 V, tipo IEC LR 6, alcaline, al manganese), in alternativa come alimentazione opzionale: alimentatore DC 6 V, n. d'ordine 410-7-150

IT

Specifiche tecniche

Durata tipica delle batterie:	500 cicli di misurazione (a seconda della pressione di gonfiaggio e della frequenza d'uso)
Controllo carica batterie:	simbolo sullo schermo
Peso:	250 g senza batterie
Dimensioni (lorgh. x alt. x prof.):	96 mm x 68 mm x 130 mm
Classificazione:	Prodotto medicale con sorgente d'energia interna (con funzionamento a batteria) / Classe II (con funzionamento a batteria), modalità continua
Parte applicata:	tipo BF (✉)
Protezione contro oggetti solidi:	IP20 La classificazione IP è il grado di protezione fornito dalle custodie in conformità con IEC 60529. Questo dispositivo è protetto contro oggetti estranei solidi di diametro di 12 mm e maggiori, come le dita. Questo dispositivo non è protetto contro l'acqua.

IT

Specifiche tecniche

Test clinico:	la precisione di misurazione è conforme ai requisiti della norma ISO 81060 Parte 2
Bluetooth:	Bluetooth versione 4.0
Deviazione massima della misurazione della pressione del bracciale:	$\pm 3 \text{ mmHg}$ o 2% del valore rilevato (vale il valore maggiore)
Deviazione massima della misurazione delle pulsazioni:	$\pm 5 \%$
Norme di riferimento:	DIN EN ISO 80601-2-30 „Medical electrical equipment - Part 2-30: Particular requirements for the basic safety and essential performance of automated type non-invasive sphygmomanometers”.
comunicazione wireless:	VZ (MURATA Manufacturing Co. Ltd.) Bluetooth Ver.4.OLE BLP Banda di frequenza : 2402-2480 MHz Potenza di uscita massima RF: 1.6dBm Modulazione: GFSK

IT

Istruzioni per il controllo metrologico

(solo per il personale specializzato addestrato)

Il controllo metrologico deve essere effettuato almeno ogni 2 anni da parte delle seguenti istituzioni o persone:

- produttore
- competente autorità di metrologia
- persone che soddisfano i requisiti delle norme di utilizzo dei prodotti medicali.

A) Prova di funzionalità

La prova di funzionalità dell'apparecchio può essere effettuata unicamente su persone o con un simulatore idoneo.

B) Controllo di tenuta del circuito di pressione e deviazioni dell'indicatore di pressione

Avvertenze

- a) Se la pressione di gonfiaggio in modalità misurazione supera i 299 mmHg, la valvola di scarico rapido dell'aria apre il circuito di pressione. Se la pressione in modalità verifica supera i 320 mmHg, lo schermo lampeggia.
- b) I controlli di calibrazione devono essere effettuati con una speciale spina. Questo test è fornibile a pagamento. Nel circuito di pressione deve essere inoltre inserita una pompa a palloncino.

Istruzioni per il controllo metrologico

(solo per il personale specializzato addestrato)

Procedura di verifica

- 1.) Rimuovere le batterie.
- 2.) Tenere premuto il pulsante Start e inserire le batterie.
- 3.) Rilasciare il pulsante Start.
L'apparecchio è ora in modalità verifica; nelle aree SIS e DIA viene visualizzata la pressione attuale.
- 4.) Verificare come d'abitudine le deviazioni dell'indicatore di pressione e la tenuta del circuito di pressione (tenendo conto del tempo di assestamento del bracciale, che comporta almeno 30 sec.).

5.) Spegnere l'apparecchio premendo nuovamente il pulsante Start.

 Non effettuare operazioni di assistenza e manutenzione mentre l'apparecchio viene utilizzato.

IT

Índice de contenido

Visión global del aparato	196
Volumen de suministro	197
Símbolos en el esfigmomanómetro y en la aplicación	198
Símbolos en el adaptador de red	201
Guía rápida	202
Introducción	203
Finalidad de uso	204
Valores de la tensión arterial	205
Valor sistólico y diastólico de la tensión arterial	205
Valores límite de la OMS para la clasificación de la tensión arterial	205
Puesta en marcha del tensiómetro	207
Colocar las baterías	207
Indicador de estado de la batería	208
Consejos que debe seguir cuando se tome la tensión	209
Indicaciones generales sobre comunicaciones Bluetooth	211
Preparativos para tomarse la tensión	213
Notas sobre el tamaño del brazalete	213



Índice de contenido

Colocación del brazalete	214
Medición de la tensión arterial	217
Interrupción de la medición	218
Pantalla de valores de medición	219
Configurar la aplicación y establecer la conexión	221
Medir y transferir la presión arterial	225
Evaluar y enviar las mediciones	227
Borrar valores de medición	229
Conexión a la red eléctrica	230
Pantalla de error	231
Limpieza y desinfección	234
Condiciones de Garantía	235
Servicio de atención al cliente / Eliminación	236
Datos técnicos	237
Instrucciones de comprobación para el control de la técnica de medición (sólo para personal cualificado)	240



Visión global del aparato



Volumen de suministro

1 tensiómetro de la serie
boso medicus system



4 pilas LR 6 (AA)



1 brazalete universal
CA 04



1 instrucciones
de uso



1 estuche



Símbolos en el esfigmomanómetro

Símbolo	Función/significado
	Tecla INICIO/PARADA
	Corriente continua
	Número de serie
	Año de fabricación
	Tipo BF: El aparato, el manguito y los tubos se han diseñado para proteger al paciente contra descargas eléctricas.
	Comunicación Bluetooth activa.
	Medición en curso. Parpadea en cuanto se haya detectado un latido cardíaco.

Símbolos en el esfigmomanómetro

Símbolo	Función/significado
	Alteración del ritmo cardíaco o movimiento durante la medición.
	Batería totalmente cargada.
	Batería parcialmente descargada.
	Sustituya la batería a la mayor brevedad posible.
	¡Intermitente! No son posibles más mediciones Sustituir las baterías.
	Proteger de la humedad

Símbolos en el esfigmomanómetro y en la aplicación

Símbolo	Función/significado
SYS	Presión arterial sistólica en mmHg
DIA	Presión arterial diastólica en mmHg
PUL	Pulso por minuto
Arr	Medición co alteración del ritmo cardíaco o movimiento
CE 0124	El aparato cumple la Directiva sobre Productos Sanitarios europea.
	El aparato no se debe eliminar en la basura doméstica.
	Fabricante
	Leer las instrucciones de uso
	Polaridad del conector para el adaptador de red

Símbolos en el adaptador de red

Símbolo	Función/significado
	Solo para el uso en locales cerrados.
	Aparato de la clase de protección II
	Termofusible
	Fusible
	El aparato cumple la Directiva sobre Productos Sanitarios europea
	Polaridad del enchufe de conexión de red

Guía rápida

- ▶ Inserte las baterías asegurándose de que la polarización es la correcta (pág. 207).
- ▶ Conecte el brazalete con el tensiómetro (pág. 213).
- ▶ Coloque el brazalete (pág. 214).
- ▶ Para iniciar (o interrumpir) una medición pulse el botón de inicio que corresponda (pág. 217).

Los valores de medición correspondientes a la sistole, diástole y el pulso se muestran una vez realizada la medición (pág. 219).

⚠ Esta guía rápida no puede sustituir los datos detallados que se incluyen en las instrucciones de uso y que se refieren al manejo y la seguridad de su tensiómetro.



Lea atentamente dichas instrucciones en su totalidad.

Introducción

Estimado cliente: nos alegramos de que haya decidido adquirir un tensiómetro boso. La marca boso representa un máximo nivel de calidad y precisión y es también el número 1 entre los profesionales. El 96% de todos los médicos de cabecera, practicantes e internistas alemanes trabajan en sus consultas con un esfigmomanómetro de boso. (estudio API de GfK 01/2016). La larga experiencia en el campo profesional se encuentra también en todos los equipos de paciente que se utilizan para tomarse la tensión en casa. Este aparato se ha sometido a nuestros estrictos controles de calidad y, por lo tanto, es una herramienta segura para controlar sus valores de tensión arterial.

⚠ Lea estas instrucciones de uso antes de utilizar el tensiómetro por primera vez,

pues la tensión arterial sólo podrá medirse correctamente si el aparato se utiliza correctamente.

En estas instrucciones de uso el símbolo „**→**“ precede a una acción que debe realizar el usuario.

Para obtener ayuda con la puesta en funcionamiento, el uso o el mantenimiento, póngase en contacto con su distribuidor o con el fabricante (datos de contacto en la contraportada de este manual).

El fabricante debe ser informado inmediatamente de cualquier estado de funcionamiento inesperado o incidente que haya empeorado o que haya podido empeorar el estado de salud.

Si vende el aparato, no se olvide de incluir también estas instrucciones de uso.



Introducción

El tensiómetro boso-medicus system puede utilizarse con pacientes que tengan un contorno del antebrazo comprendido entre 22 y 48 cm.

La utilización de accesorios no indicados en las instrucciones de uso puede comprometer la seguridad.

Dispositivos de comunicación inalámbricos, como teléfonos móviles, teléfonos inalámbricos y sus estaciones base, walkie-talkies y los dispositivos de redes inalámbricas domésticas pueden afectar a este monitor de presión arterial. Por lo tanto, debe mantenerse una distancia mínima de 30 cm con estos dispositivos.

La transmisión radioeléctrica Bluetooth del aparato corresponde a la Directiva de equipos de radio 2014/53/EU.

Finalidad de uso

Registro no invasivo del valor sistólico y diastólico de la presión arterial, así como de la frecuencia de pulso en adultos. No adecuado para el uso en recién nacidos y lactantes. El aparato es adecuado para la automedición en casa. El paciente está previsto como usuario.

El dispositivo puede utilizarse con cualquier perímetro de brazo según lo indicado en el manguito correspondiente.

Valores de la tensión arterial

Para determinar correctamente el valor de la tensión arterial, deben medirse **dos valores**:

● **Valor sistólico (superior) de la presión arterial:**

Se produce cuando el músculo del corazón se contrae e impulsa la sangre hacia los vasos sanguíneos.

● **Valor diastólico (inferior) de la tensión arterial:**

Se produce durante la dilatación del músculo del corazón, lo que permite que éste vuelva a llenarse de sangre.

Los valores de la presión sanguínea se expresan en mmHg (mm de columna de mercurio).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido los siguientes parámetros como guía para clasificar la tensión arterial.

	sistólica	diastólica
Alta (hipertensión)	a partir de 140 mmHg	a partir de 90 mmHg
Normal-Alta	130 a 139 mmHg	85 a 89 mmHg
Normal	120 a 129 mmHg	80 a 84 mmHg
Óptima	hasta 119 mmHg	hasta 79 mmHg



Valores de la tensión arterial

La necesidad de un tratamiento médico no sólo depende de los indicadores de la tensión, sino también del perfil de riesgo de cada paciente. Consulte a su médico si cualquiera de los valores (sistólico diastólico) de su tensión arterial se encuentra siempre claramente por encima del límite.

Cuando uno se toma la tensión en casa, los valores suelen ser más reducidos que

en la consulta del médico. Por esta razón, la Asociación Alemana contra la Hipertensión ha establecido límites más bajos para la medición en casa:

Medición en casa: 135/85 mmHg

Medición en la consulta: 140/90 mmHg

Puesta en marcha del tensiómetro

El dispositivo debe ser instalado y puesta en funcionamiento de acuerdo a la información de este manual.

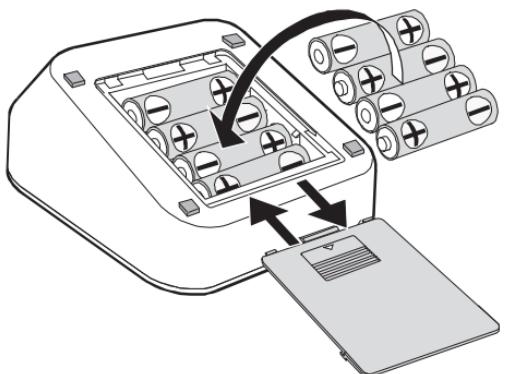


Figura 1

→ Utilice exclusivamente las pilas recomendadas, de alta calidad y a prueba de pérdidas (véase apartado "Datos Técnicos", en la página 237).

⚠ Nunca utilice pilas usadas con pilas nuevas o de diferentes fabricantes.

⚠ Si coloca mal las pilas, el aparato no funcionará, lo que puede provocar la generación de calor, hacer que se derramen las baterías u ocasionar daños en el tensímetro.

→ Colocación de las pilas

El compartimiento de las pilas está situado en la parte inferior del aparato. Coloque las pilas en su compartimento tal y como se muestra en la figura 1.

→ Si no piensa utilizar el aparato durante un largo período de tiempo, retire las pilas.

⚠ Si las baterías se cortocircuitan, pueden calentarse y provocar quemaduras.



Puesta en marcha del tensiómetro

El tensiómetro posee una pantalla de estado que muestra el nivel de carga de la batería (véase página 199).

-  Las pilas están llenas.
-  Las pilas parcialmente descargadas.
-  Las pilas deberán cambiarse dentro de poco.
-  Símbolo intermitente. No es posible efectuar ninguna medición más. Cambie las pilas de inmediato.



Cuide el medio ambiente.

Las pilas usadas y los aparatos de recarga no se pueden eliminar con la basura doméstica.

Hay que depositarlos en contenedores especiales y centros de recogida de pilas usadas o residuos especiales. Consulte con su ayuntamiento para conocer las normas de su localidad.

Consejos que debe seguir cuando se tome la tensión

1. Las diferencias en los valores de la tensión arterial son normales. Los resultados pueden ser muy diferentes incluso cuando se realiza más de una medición consecutiva. Una medición aislada, o la realización de mediciones a intervalos irregulares, no ofrecen ninguna conclusión fiable sobre el valor real de la tensión arterial. Para tener una idea exacta y fiable del estado de la tensión, es necesario tomársela a intervalos de tiempo periódicos y en condiciones similares; los resultados se anotarán después en la ficha de control de la tensión arterial.
2.  Tomarse la tensión personalmente no significa que uno pueda automedicarse. No cambie nunca las dosis de la medicación que le ha recetado su médico sin consultarle.
3. Las alteraciones en el ritmo cardíaco pueden afectar a la precisión de medición del tensiómetro o incluso provocar valores de medición incorrectas (véase página 232).
4. En los pacientes con un pulso débil (lo que puede suceder, por ejemplo, en los pacientes que llevan un marcapasos) también pueden producirse mediciones incorrectas. El tensiómetro no afecta en modo alguno al buen funcionamiento del marcapasos.
5. El aparato no ha sido validado para la utilización en embarazadas.



Consejos que debe seguir cuando se tome la tensión

6. Tómese la tensión siempre cuando esté tranquilo y relajado.

Se recomienda hacerlo dos veces al día, a saber, por la mañana y por la noche, antes de acostarse, cuando ya se haya olvidado del estrés del trabajo.

7. La tensión arterial (cuando no existen limitaciones, véase pág. 215) debe tomarse siempre en el brazo con los valores de tensión más altos.

Así pues, mida primero la tensión arterial en los dos brazos y, a partir de ese momento, hágalo siempre en el brazo en el que haya obtenido la medición más alta.

Indicaciones generales sobre comunicaciones Bluetooth

-  El aparato para medición de la tensión arterial no pueden ser empleado en lugares en los que la comunicación inalámbrica está prohibida como p.ej. en aviones y hospitales.

Este aparato para medición de la tensión arterial puede tener efectos negativos sobre aparatos electrónicos o aparatos eléctricos medicinales.

- La distancia máxima de comunicaciones entre el aparato para medición de la tensión arterial y el receptor es de aprox. 10 Meter. Esta distancia puede reducirse en función del entorno; compruebe por ello si la distancia para la transmisión de datos tras la medición es lo suficientemente reducida.
- Cuide de que el ambiente entre el apa-

rato para medición de la tensión arterial y el dispositivo móvil no esté obstruido. La distancia de comunicación puede haberse acortado debido a la ejecución de construcción del edificio u otros obstáculos. Especialmente bajo ciertas circunstancias no es posible una comunicación a través de paredes de hormigón armado etc.

- Durante el enlace todos los otros aparatos Bluetooth que se encuentran en el radio de alcance deben estar desactivados.
- En caso de que se presente alguna situación improbable que este aparato para medición de la tensión arterial interfiera en aparatos de comunicación inalám-



Indicaciones generales sobre comunicaciones Bluetooth

brica, utilice el aparato para medición de la tensión arterial en otro emplazamiento.

- No emplee la comunicación Bluetooth en las cercanías de un dispositivo IEEE802.11g/b/n-WLAN u otras instalaciones de comunicación inalámbrica (especialmente en el rango de 2,4 GHz) o bien en las cercanías de aparatos que emitan ondas electromagnéticas (como p.ej. aparatos de microondas) Esto puede conducir a que la comunicación se interrumpa frecuentemente, la velocidad de comunicación se reduzca notablemente y se presenten errores.



Preparativos para tomarse la tensión

Nota sobre el tamaño del brazalete:

⚠ Este aparato puede utilizarse exclusivamente con los tipos de brazalete que se indican a continuación, y que deben seleccionarse en función del contorno del antebrazo del paciente.

Tipo	Contorno del antebrazo	Número de referencia
CA01	22 – 32 cm	143-4-764
CA02	32 – 48 cm	143-4-757
CA04	22 – 42 cm	143-4-765*

* Éste es el tamaño universal que se incluye en el volumen de suministro estándar.

Conecte el brazalete al tensiómetro introduciendo con el conector (hasta oír un clic) en la entrada situada en el lado izquierdo del tensiómetro (véase figura 2).

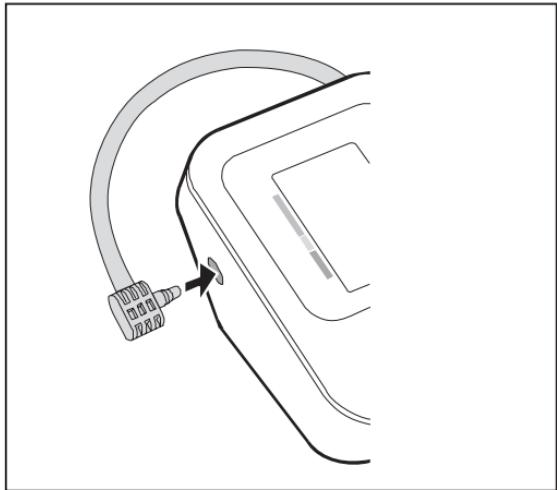


Figura 2



Preparativos para tomarse la tensión

Factores que deben tenerse en cuenta al tomarse la tensión



Evite tomar café o fumar una hora antes de tomarse la tensión.



Siéntese cómodamente para proceder a la medición, manteniendo apoyados la espalda y los brazos. No cruce las piernas y apoye los pies directamente en el suelo. Relájese durante 5 minutos y, después, tómese la tensión. No se mueva mientras el tensiómetro esté tomando los valores.



Ajuste del brazalete

La medición debe realizarse sobre el antebrazo desnudo.



Asegúrese de que no se impida la libre circulación de la sangre en el brazo como consecuencia de haber levantado la manga para descubrir el antebrazo y, en caso necesario, retire por completo la prenda de vestir antes de realizar la medición.

→ Mueva el brazalete abierto en forma de anillos por el antebrazo hasta que el borde inferior se encuentre aprox. a 2 o 3 cm por encima de la parte interior de la articulación del codo. Además, el brazalete debe colocarse de tal modo que la marca se encuentre sobre la arteria (véase figura 3).

Preparativos para tomarse la tensión

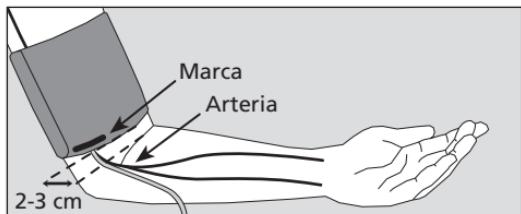


Figura 3

⚠ No coloque el brazalete sobre una herida, pues esto puede empeorar aún más la lesión.

⚠ No coloque el brazalete en un brazo cuyas arterias o venas se encuentren bajo tratamiento médico (por ejemplo, shunt o derivación).

⚠ En el caso de las mujeres a las que se les haya amputado una mama, no coloque el brazalete en el brazo correspondiente al lado amputado.

⚠ Durante la medición pueden producirse errores en otros aparatos médicos que se utilicen al mismo tiempo en el mismo brazo.

⚠ El brazalete no debe estar muy ajustado; tiene que quedar espacio suficiente para introducir dos dedos entre brazalete y brazo.

⚠ El anillo metálico **no debe** quedar nunca sobre la arteria (véase figura 3), puesto que esto falsearía el resultado de los valores de medición.

→ Tire del extremo del brazalete que se ha introducido por el anillo metálico y rodee el antebrazo enrollando hacia afuera. Cierre con el velcro ejerciendo una ligera presión.

Preparativos para tomarse la tensión

- Apoye el brazo ligeramente doblado y con el brazalete ya colocado sobre una mesa, de manera que el brazalete quede a la altura del corazón y el brazo esté relajado.

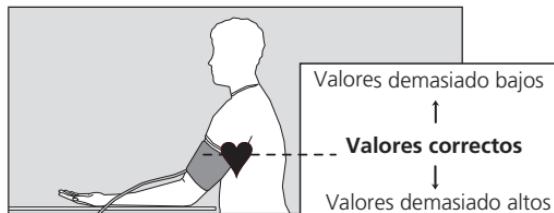


Figura 4

 No hable mientras el tensiómetro esté tomando los valores.

 **!** Asegúrese de que el tubo de aire no se doble mientras de infla durante la medición, pues esto podría provocar la formación de coágulos de sangre y, en consecuencia, ocasionarle una lesión.

! No interrumpa la circulación de la sangre durante un tiempo innecesariamente largo (más de dos minutos) para efectuar una medición. Si el tensiómetro presenta un error de funcionamiento, retire el brazalete del brazo.

! Si se toma la tensión con demasiada frecuencia, la circulación sanguínea puede verse afectada, lo que puede provocar lesiones.

! El aparato no debe ser utilizado por niños sin supervisión.

! No utilice el aparato cerca de lactantes. Esto puede provocar accidentes o daños.

! Hay pequeñas partes que pueden causar un riesgo de asfixia si se ingiere por error por los bebés.

⚠ No iniciar el aparato sin haber aplicado el manguito.

⚠ Si se produce un cambio importante de la temperatura ambiente, deje que el aparato se aclimate durante aprox. una hora a la nueva temperatura ambiente antes de utilizarlo.

⚠ El rendimiento del aparato puede verse alterado por temperaturas excesivas, la humedad o la altitud.

Medición de la tensión arterial

→ Inicie la medición con el botón de inicio



⚠ Ahora permanezca totalmente inmóvil y en silencio.

A efectos de prueba de funcionamiento aparecen brevemente todos los elementos indicadores de la pantalla LCD (véase figura 5).

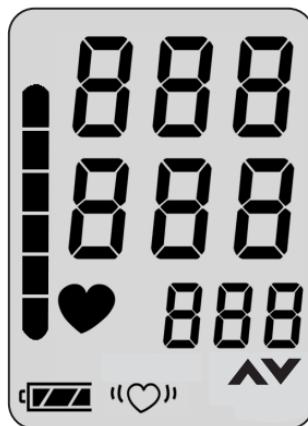


Figura 5



Medición de la tensión arterial

La bomba empieza a inflar el brazalete.

El tensiómetro incorpora un sistema inteligente de inflado que garantiza que el brazalete se infla hasta una presión adecuada que no resulte agresiva para el brazo. El incremento de la presión del manguito se indica como valor numérico digital y en forma de barras en el borde izquierdo del display.

Una vez alcanzada la **presión necesaria** la bomba se desconecta y el brazalete empieza a desinflarse.

⚠ Interrupción de la medición:

Si desea interrumpir la toma de la tensión, puede hacerlo en cualquier momento pulsando el botón de inicio mientras la medi-

ción esté en curso. En este caso, el brazalete se desinflará de forma automática.

Durante la fase de medición en la pantalla aparece el progreso en la reducción de la presión del brazalete, junto con el símbolo  (véase fig. 6).



Figura 6

Pantalla de valores de medición

Una vez tomada la tensión, la válvula magnética interna se abre automáticamente para permitir el desinflado rápido del brazalete.

Los valores de tensión arterial medida (sístole, diástole, pulso) aparecen en la pantalla (véase figura 7).



Figura 7

Si después de la medición aparece el símbolo “(♥)”, se recomienda volver a tomar la tensión, pero esta vez manteniendo el brazo completamente inmóvil. Si vuelve a aparecer este símbolo “(♥)” en la pantalla después de volver a tomar la tensión con el brazo inmóvil, puede que exista una alteración del ritmo cardíaco. Consultelo con su médico en la próxima visita.

La tensión arterial es una magnitud dinámica que puede verse afectada por diversos factores, como la posición del paciente (no es lo mismo si está sentado, de pie, tumbado o en movimiento), o por las condiciones físicas o anímicas presentes en el momento de realizar la medición (estrés, presencia de una enfermedad, etc.).

- Se observa que el resultado es claramente incorrecto, repita el proceso.



Pantalla de valores de medición

El tensiómetro se desconecta automáticamente después de aprox. 1 minuto. Para repetir la medición vuelva a pulsar **brevemente** el botón de inicio que corresponda.



Espere al menos dos minutos entre cada medición.

- Si no desea volver a tomar la tensión, retire el brazalete del brazo.

Configurar la aplicación y establecer la conexión



Requiere interacción con boso-App



Requiere interacción con boso medicus system

Para permitir el intercambio de datos entre el tensiómetro y su dispositivo móvil, se deben tener en cuenta los pasos siguientes:



– Asegúrese de que esté activado Bluetooth en su dispositivo móvil. (Se requiere Bluetooth 4.0)

– Descárguese la aplicación de boso del Google/Apple Store.



Durante la instalación de la aplicación, el sistema operativo (Android/iOS) solicitará permiso para acceder a la ubicación actual.

Responda con "Sí" para evitar errores en la conexión Bluetooth.


Nota: La aplicación boso no requiere la "ubicación actual" de la información, sino el sistema operativo para la conexión Bluetooth.



Configurar la aplicación y establecer la conexión



- Inicie la aplicación de boso en su dispositivo móvil.
- Cree un nuevo usuario:
 1. Seleccione "Usuario" en el menú principal.
 2. Seleccione "+ Nuevo" en la barra de menú inferior.
 3. Introduzca sus datos personales. Los campos obligatorios están identificados con "*".
 4. Guarde sus entradas con el botón "Guardar" de la barra de menú inferior.
- Seleccione mediante una marca de verificación el usuario, para el cual se deben guardar los valores de medición.

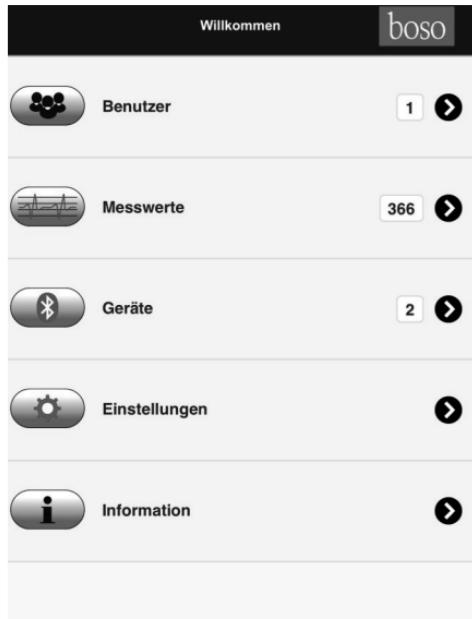

Configurar la aplicación y establecer la conexión



- Vuelva al menú principal con el botón "Atrás" de la barra de menú superior.
- Abra el menú principal "Dispositivos"



- Pulse y mantenga pulsado el botón de inicio "START" del tensiómetro, hasta que en la pantalla aparezca "Pr". Durante aprox. un minuto se muestra en la pantalla la indicación de comunicación.



- En el menú "Dispositivos", seleccione "Añadir nuevo dispositivo" en la barra de menú inferior.



En iOS se debe confirmar además la consulta de acoplamiento con "Acoplar".



- El dispositivo móvil sincronizará automáticamente la fecha y la hora.



- Tras un exitoso enlace aparece "End" en el display del dispositivo y este se indica en la lista de dispositivos de la aplicación.

Ahora ha finalizado la configuración. Salga del menú con el botón "Atrás" de la barra de menú superior.



Configurar la aplicación y establecer la conexión

Tras un cambio de batería, el tensiómetro se debe volver a acoplar con el dispositivo móvil, ya que se borrará la hora debido al cambio de la batería.

Si no se realiza un nuevo acoplamiento, durante la transmisión de datos se almacenará la hora del sistema actual del dispositivo móvil como marca de hora para los valores de medición.

Proceda de la forma siguiente:

- Borre el tensiómetro de la lista de dispositivos de la aplicación
- Borre los ajustes de Bluetooth del dispositivo móvil
- Realice el nuevo acoplamiento de la forma descrita.

Medir y transferir la presión arterial

Aplique el manguito y realice una medición de la presión arterial como se describe en las instrucciones de uso.



Mientras esté activo Bluetooth y abierta la aplicación, los valores medidos se transferirán automáticamente una vez haya finalizado la medición.



Después de una transferencia correcta, el valor de medición se borrará de la memoria de valores de medición del tensiómetro.



Si no se han transferido los datos de medición, vuelva a ejecutar el acoplamiento. Si la aplicación o la

conexión Bluetooth está inactiva, se almacenarán automáticamente un máximo de 30 valores de medición en el tensiómetro (Si la memoria de valores de medición está llena (30 mediciones), se borrará la medición más antigua y se guardará la actual; no se guardan las mediciones incorrectas) y se transferirán después de la próxima medición, cuando se haya activado la aplicación.

Para transferir a la aplicación todos los valores de medición almacenados en la memoria de valores de medición del medicus system, debe estar activada en el menú "Configuración" la transferencia de to-




Medir y transferir la presión arterial

dos los valores de medición (ajuste predeterminado). Si selecciona aquí "último", se transferirá solo el último valor de medición medido y se borrarán todos los valores de medición almacenados.

En este menú también se pueden modificar las horas para la evaluación de la mañana/tarde.

Guarde sus ajustes con el botón "Guardar" de la barra de menú inferior.

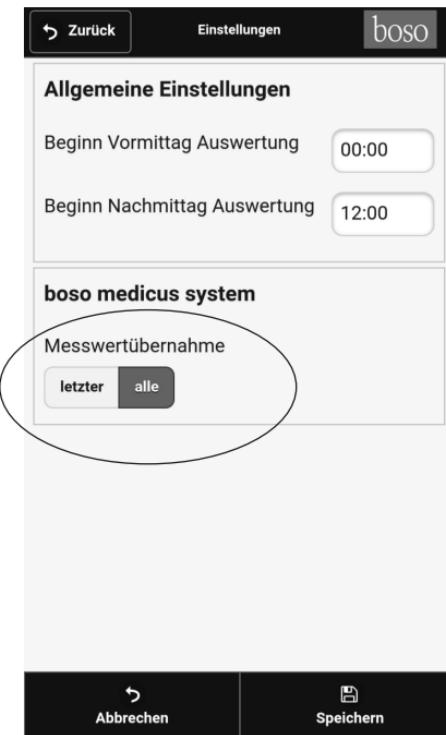

Evaluar y enviar las mediciones




En el menú "Valores de medición" se muestran todos los valores de medición transmitidos hasta el momento.

A través del botón "Gráficos" de la barra de menú inferior podrá acceder a la representación gráfica de los valores de medición.

Seleccione los gráficos disponibles "SIS/ DIA", "PULSO" a través de los botones de la sección superior de la imagen. Toque el gráfico para ampliarlo o reducirlo.

La opción "kg/IMC" está prevista para una báscula.

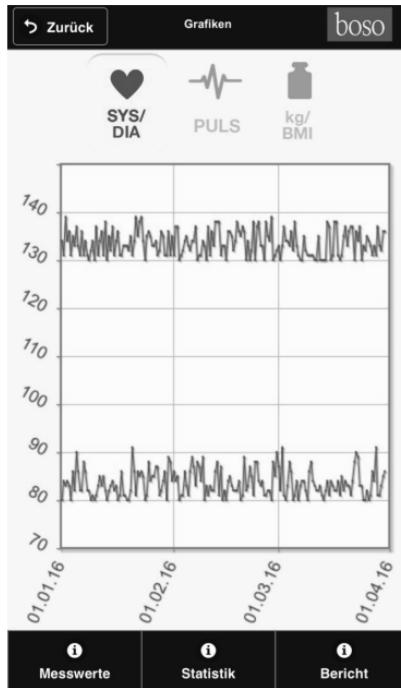

Evaluar y enviar las mediciones



A través del botón "estadística" de la barra de menú inferior accederá al resumen estadístico de los valores de medición. Se puede seleccionar el intervalo temporal del resumen (fecha desde/hasta).

A través del botón "Informe" de la barra de menú inferior accederá al menú de envío de los valores de medición; en este podrá enviar el resumen por correo electrónico en formato PDF o XML.

El archivo XML se puede leer en el programa de PC "boso profil-manager XD Home".

Este programa ofrece posibilidades de evaluación adicionales y está disponible gratuitamente en Internet

(<http://www.boso.de/download/profilmanagerXDHome/>).



Borrar valores de medición



En el menú "Valores de medición" se pueden borrar con el botón "Borrar" de la barra de menú inferior valores de medición individuales o valores de medición más antiguos que 1/3/6/12 meses.

Atención, los datos se borrarán de forma irrecuperable. Realice a tiempo un archivado de datos, creando con el símbolo "Informe" un archivo XML o PDF.

		Messwerte Max Mustermann					boso
		SYS	DIA	PUL	Arr	kg	
17.10.2018 11:09:00	-	-	-	-	-	85	<input type="checkbox"/>
30.03.2016 18:00:00	136	86	66	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30.03.2016 08:00:00	-	-	-	-	-	78,5	<input type="checkbox"/>
30.03.2016 08:00:00	136	85	68	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29.03.2016 18:00:00	-	-	-	-	-	78,8	<input type="checkbox"/>
29.03.2016 18:00:00	132	83	67	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29.03.2016 08:00:00	-	-	-	-	-	78,7	<input type="checkbox"/>
29.03.2016 08:00:00	133	81	65	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28.03.2016	-	-	-	-	-	78,9	<input type="checkbox"/>

Statistik **Grafiken** **Bericht** **Eingabe Gewicht** **Löschen**

Conexión a la red eléctrica

En la parte posterior del aparato se encuentra el conector hembra para el adaptador de alimentación. En caso necesario, utilice únicamente el adaptador de alimentación boso (**nº ref. 410-7-150**). Este adaptador de alimentación se ha ajustado, estabilizado y polarizado de forma precisa para la tensión del aparato. Esto significa que los adaptadores de otros fabricantes pueden provocar un daño en el sistema electrónico, lo que a su vez anulará la garantía. Además, los adaptadores de alimentación de otros fabricantes pueden desencadenar un incendio.

 No toque simultáneamente las baterías, la conexión del adaptador de red y el paciente.

 Si no lo va a utilizar, extraiga el conector del adaptador de red del esfigmomanómetro.

Pantalla de error

Si durante la toma de la tensión se produce algún problema que impida el correcto funcionamiento del aparato, en la pantalla aparece un error en lugar de los resultados de la medición.

Significado de los mensajes de error:

Causa del error del indicador Err:	Solución del error:
	La presión del brazalete presenta fuertes oscilaciones durante la medición
	Mantenga el brazo quieto
No se puede evaluar el pulso	Revise la posición del brazalete (véase pág. 214) y vuelva a realizar la medición.
La diferencia entre la sístole y la diástole es demasiado reducida Sístole – Diástole \leq 10 mmHg	Revise la posición del brazalete (véase pág. 214) y vuelva a realizar la medición.
	Errore di gonfiaggio
	Il bracciale potrebbe essere troppo largo; stringere il bracciale (vedere pag. 214)



Pantalla de error

Causa del error del indicador Err: Risoluzione del problema



El valor del pulso no se puede determinar correctamente Compruebe la posición del manguito y repetir la medición.



Error interno

Retire las pilas y pulse brevemente el botón START. Ponga las pilas de nuevo en el monitor. Si el error persiste, enviar el aparato al fabricante para su reparación.



" \heartsuit " Indicador

Solución del error:

Repita la toma de la tensión manteniendo el brazo inmóvil. Si vuelve a aparecer este símbolo " \heartsuit " en la pantalla después de volver a tomar la tensión con el brazo inmóvil, puede que exista una alteración del ritmo cardíaco. Consultelo con su médico en la próxima visita.

Pantalla de error

Causa del error del indicador Err: Risoluzione del problema



Error en la
comunicación
Bluetooth

Retire las pilas y pulse brevemente el botón START. Ponga las pilas de nuevo en el monitor. Realice un nuevo enlace. Si el error persiste, enviar el aparato al fabricante para su reparación.



Durante la instalación de la aplicación, el sistema solicitará permiso para acceder a la ubicación actual. Responda con "Sí" para evitar errores en la conexión Bluetooth.

Limpieza y desinfección

Limpieza Tensiómetro:

Utilice exclusivamente un paño suave y seco para limpiar este aparato.

Limpieza Brazalete:

Las manchas no muy intensas pueden eliminarse con un detergente para lavavajillas estándar.

Desinfección:

Para la desinfección por fregado (tiempo de aplicación de al menos 5 minutos) del dispositivo y el manguito, recomendamos el producto desinfectante antifect liquid (Schülke & Mayr). Para desinfectar el manguito, se recomienda desinfección por pulverización.

Especialmente si el dispositivo se usa en varios usuarios, el manguito deberá limpiarse y desinfectarse regularmente.



Condiciones de Garantía

Damos una garantía de 3 años desde la fecha de compra. La fecha de la compra se tiene que poder comprobar con la factura de venta. Dentro del período de garantía contra defectos de fabricación, se arreglarán estos de forma gratuita. La reparación no prolonga el periodo de garantía, sólo en el componente reemplazado.

Quedan excluidas de la garantía las partes sujetas a desgaste normal (por ejemplo, manguito), daños por transporte y daños causados por un manejo inadecuado (por ejemplo, el incumplimiento de las instrucciones de uso). Los daños debidos a desmontajes realizados por personas no autorizadas están excluidos de la garantía. No hay reclamaciones por daños y perjuicios contra nosotros están justificadas por la garantía.

En el caso de reclamaciones de garantía justificado el dispositivo tiene que ser enviado con la factura original a:

BOSCH + SOHN GMBH U. CO. KG,
Bahnhofstr. 64, D-72417 Jungingen.

boso no asume ninguna responsabilidad por pérdidas generadas como p.ej. anomalías de servicio o pérdida de datos que puedan presentarse con el empleo de este aparato para medición de la tensión arterial.

No se garantiza que este aparato para medición de la tensión arterial pueda establecer una comunicación con todos los dispositivos compatibles con Bluetooth.



Servicio de atención al cliente

Servicio de atención al cliente:

Los trabajos de reparación y los que se realicen dentro del período de garantía deben correr a cargo de personal debidamente formado y autorizado. No modifique este equipo sin la autorización del fabricante. Envíe el tensiómetro bien embalado y correctamente franqueado a su distribuidor, o bien directamente a:

BOSCH + SOHN GmbH u. Co. KG
Serviceabteilung
Bahnhofstraße 64, D-72417 Jungingen
T: +49 (0) 74 77 / 92 75-0

Eliminación



Ni el tensiómetro ni las pilas pueden eliminarse con la basura doméstica.

Al final de la vida útil del tensiómetro, éste debe llevarse a un punto de recogida destinado a equipos electrónicos usados.

Recuerde que las pilas y las baterías recargables deben eliminarse por separado (en el centro de recogida de su localidad).

Vida útil estimada del dispositivo: 5 años (Usando la unidad 6 veces al día).

Vida útil esperada del manguito: 22 años (Usando la unidad 6 veces al día).

Datos técnicos

Principio de medición:	Oscilométrico
Intervalo de medición:	sistólica: 60 a 279 mmHg diastólica: 40 a 200 mmHg Pulso: 40 a 180 por minuto
Presión del brazalete:	0 a 299 mmHg
Número de memorias:	30 mediciones cada una
Pantalla:	LCD
Condiciones de funcionamiento:	Temperatura ambiente: +10°C a +40°C Humedad relativa del aire: 15 a 85 % Presión atmosférica de 800 hPa hasta 1060 hPa
Transporte / Condiciones de almacenamiento:	Temperatura ambiente: -20°C a +60°C Humedad relativa del aire: 10 a 95 % Presión atmosférica de 700 hPa hasta 1060 hPa
Tensión de alimentación:	6V CC (4 pilas x 1,5 MI IEC LR6, manganeso alcalino) alternativamente como equipamiento especial: adaptador de alimentación 6V CC; nº ref. 410-7-150



Datos técnicos

Duración habitual de la batería:	500 ciclos de medición (dependiendo del nivel de inflado y la frecuencia de uso)
Indicador de estado de las pilas:	Indicador en la pantalla LCD.
Peso:	250 g sin las pilas
Dimensiones (an x al x pr):	96 mm x 68 mm x 130 mm
Clasificación:	Producto sanitario con fuente de energía interna (funcionamiento con batería) / clase II (con fuente de alimentación), modo de funcionamiento continuo
Parte aplicada:	tipo BF (✉)
Protección contra objetos sólidos:	IP20 La clasificación IP es el grado de protección proporcionado por los recintos de acuerdo con IEC 60529. Este dispositivo está protegido contra objetos extraños sólidos de 12 mm de diámetro y mayores como los dedos. Este dispositivo no está protegido contra el agua.



Datos técnicos

Ensayo clínico:	la precisión de medición corresponde a los requisitos de la norma ISO 81060 Parte 2.
Bluetooth:	Bluetooth Versión 4.0
Desviación máxima de medición del brazalete:	± 3 mmHg o 2 % del valor de lectura (se aplica el valor mayor)
Desviación máxima de la medición del pulso:	± 5 %
Normas aplicables:	DIN EN ISO 80601-2-30 „Medical electrical equipment - Part 2-30: Particular requirements for the basic safety and essential performance of automated type non-invasive sphygmomanometers” .
Comunicación inalámbrica :	VZ (MURATA Manufacturing Co. Ltd.) Bluetooth Ver.4.OLE BLP Banda de frecuencia : 2402-2480 MHz Máxima potencia de salida RF : 1.6dBm Modulación: GFSK



Instrucciones de comprobación para el control de la técnica de medición (sólo para personal cualificado)

El control de la técnica de medición debe realizarse como muy tarde cada dos años y correr a cargo de las siguientes personas:

- fabricante
- autoridades responsables de la metrología
- Personas que cumplan los requisitos del reglamento alemán sobre uso de productos sanitarios.

A) Verificación del funcionamiento

La prueba de funcionamiento sólo se puede realizar en una persona o con un simulador adecuado.



B) Verificación de la estanqueidad del circuito de presión y divergencia del indicador de presión

Notas:

- a) Si la presión aumenta por encima de los 299 mmHg en el modo de medición, la válvula de desinflado rápido se activa y abre el circuito de presión. Si la presión aumenta por encima de los 320 mmHg en el modo de comprobación, la pantalla de valores medición parpadea.
- b) Los controles de calibración, deben hacerse con un enchufe especial. Esta prueba puede hacerse previo pago. Por último, ajuste la pera de acuerdo con el circuito de presión.

Instrucciones de comprobación para el control de la técnica de medición (sólo para personal cualificado)

Verificación

- 1.) Extraiga las pilas.
- 2.) Mantenga pulsado el botón de inicio y coloque las baterías.
- 3.) Suelte el botón de inicio.
El tensiómetro se encuentra ahora en el modo de comprobación. En los campos SYS y DIA se muestra la presión actual.
- 4.) Siga el método habitual para comprobar si hay divergencias en el indicador de presión y si el circuito de presión es estanco (establezca un tiempo para el brazalete de por lo menos 30 segundos).

- 5.) Apague el aparato volviendo a pulsar el botón de inicio.

 El servicio técnico y el mantenimiento no se deben realizar si el aparato está en uso.







CE0124



**BOSCH + SOHN GmbH u. Co. KG
Bahnhofstraße 64
D-72417 Jungingen**

T + 49 (0) 74 77 92 75-0
F + 49 (0) 74 77 10 21
E zentrale@boso.de

Internet: www.boso.de